



METREL ES Manager

Návod na obsluhu

Verzia 2.1

© 2020 Micronix



Obsah

1	Vitajte v nápovede k programu Metrel ES Manager	4
2	Úvod.....	5
2.1	Čo je Metrel ES Manager?	5
2.1.1	Užívateľské rozhranie.....	5
2.1.2	Konektivita	6
3	Súhlas s licenčnými podmienkami.....	7
3.1	Dôležité upozornenie	7
3.1.1	Udelenie licencie	7
4	Inštalácia programu	8
4.1	Systémové požiadavky	8
4.2	Inštalácia programu	8
4.3	Aktualizácie programu	8
5	Začíname	10
5.1	Rýchle príručky a sprievodcovia	10
5.1.1	Úvodné príručky	10
6	Položky užívateľského rozhrania.....	11
6.1	Úvod.....	11
6.2	Ponuka Menu.....	11
6.2.1	Funkcie hlavného menu	12
6.2.1.1	Menu Nastavenia.....	13
6.2.2	Záložka Domov	15
6.2.3	Funkcie záložky Štruktúra	18
6.2.4	Záložka Databáza	20
6.3	Pracovná plocha programu	22
6.3.1	Spravovanie pracovnej plochy	23
6.3.2	Možnosti stromového pohľadu	24
6.3.3	Možnosti okna s výsledkami.....	26
6.3.3.1	Okno s výsledkami pre Pracovný rámec Bezpečnosť spotrebičov	27
6.3.4	Možnosti okna vlastnosti	29
7	Vytvorenie údajovej štruktúry	31
7.1	Základné informácie pred pridaním novej testovacej štruktúry	31
7.2	Otvorenie novej údajovej štruktúry pre projekt testovania.....	31
7.2.1	Vytvorenie novej údajovej štruktúry	31
7.2.2	Priradenie meraní k objektom štruktúry	32
7.3	Vytvorenie štruktúry použitím príkazov Kopírovať a Vložiť'	34
7.3.1	Kopírovať a Vložiť' v rámci rovnakého súboru údajovej štruktúry	34
7.3.2	Kopírovať a Vložiť' medzi rôznymi súbormi údajovej štruktúry	37
7.3.3	Kopírovať a Vložiť' medzi rozdielnymi pracovnými rámcami	39
7.4	Vytvorenie údajovej štruktúry pre opakovany test spotrebiča	39
8	Komunikácia s prístrojom	42
8.1	Nadviazanie komunikácie s prístrojom	42
8.1.1	Informácie o prístroji	42
8.1.2	Aktualizácia Firmware	43

8.2	Upload a download projektových súborov	43
8.2.1	Možnosti prenosu jedného súboru	43
8.2.2	Možnosti prenosu viacerých súborov	44
9	Tlač výsledkov	46
9.1	Možnosti tlače výsledkov	46
9.1.1	Formát tlače výsledkov	46
9.1.2	Základný report	48
9.1.2.1	Vytvorenie základného reportu	48
9.1.2.2	Vytvorenie filtrovaného základného reportu	50
10	Správy z merania	51
10.1	Vytvorenie správ	51
10.1.1	Vytvorenie novej správy krok za krokom	51
10.1.1.1	Výber formátu správy	51
10.1.1.2	Okno pre editáciu správy	52
10.1.1.3	Kontrola a vyplnenie jednotlivých stránok správy	53
10.2	Exportovanie alebo tlač finálnej správy	54
10.3	Pro Export do formátu súboru Excel	54
11	Menežovanie správ	57
11.1	Menežovanie správ	57
11.2	Opäťovné vytvorenie správ	57
12	Šablóny správ	59
12.1	Úprava šablón správ	59
12.2	Použitie šablón správ	60
13	Riešenie problémov	61
13.1	Úvod	61
13.2	Problém s pripojením prístroja	61
13.3	Oznámenie chyby do Metrelu	61
13.3.1	Obsah správy o chybe programu	61
14	Online podpora	63
14.1	Ako získať podporu?	63
14.1.1	Kontaktujte nás priamo	63
14.1.2	Využite online kontaktný formulár	63

1 Vitajte v nápovede ku Metrel ES Manager

Na výber alebo vyhľadanie témy použite záložky na ľavej strane okna. Môžete tiež použiť niektorý z nižšie uvedených Rýchlych odkazov na zoznamenie sa s programom MESM.

- [Úvod](#)
- [Online podpora](#)
- [Súhlas s licenčnými podmienkami](#)
- [Začíname](#)

Váš dodávateľ:



MERATEST s.r.o.

Družstevná 2, 916 01 Stará Turá
Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909
E-mail: molec@meratest.sk
www.meratest.sk

2 Úvod

2.1 Čo je Metrel ES Manager?

Metrel Electrical Safety Manager je PC program pre novú generáciu prístrojov Metrel. Široká paleta prístrojov na testovanie elektrickej inštalácie, elektrických spotrebičov, strojov a testerov bezpečnosti pre priemysel môže využívať rovnaký program. MESM má jednotné užívateľské rozhranie – rovnaký vzhľad, rovnaký význam.

ES Manager umožňuje predprípravu štruktúry a súvisiacich meraní na PC a ich upload do meracieho prístroja. Po vykonaní testu možno namerané výsledky stiahnuť do PC, prezerať ich, editovať, archivovať a generovať a tlač správy z merania.

Užívateľ tiež môže, podľa typu meracieho prístroja, vytvoriť vlastnú automatizovanú postupnosť merania Auto Sequences®. Tieto autosekvencie, ako aj samostatné testy, možno vložiť do zákazníkom vytvorenej štruktúry, ktorá sa následne prenesie do meracieho prístroja.


Vytvorenie správy z merania (reportu) je založené na preddefinovaných šablónach (formulároch), ktoré vychádzajú z jednotlivých národných noriem alebo pravidiel. Užívateľ vloží všetky potrebné údaje o meraní, zatiaľ čo výsledky meraní sú do formulára vložené automaticky.

Funkcionalita PC software **Metrel ES Manager** závisí na licenčnom kľúči, ktorý je vždy vztiahnutý k výrobnému číslu meracieho prístroja. Sú dva typy licenčných kľúčov:

- Licencia BASIC
- Licencia PRO

Reporty založené na preddefinovaných formulároch podľa jednotlivých národných noriem sú dostupné len licenciou PRO.

2.1.1 Užívateľské rozhranie

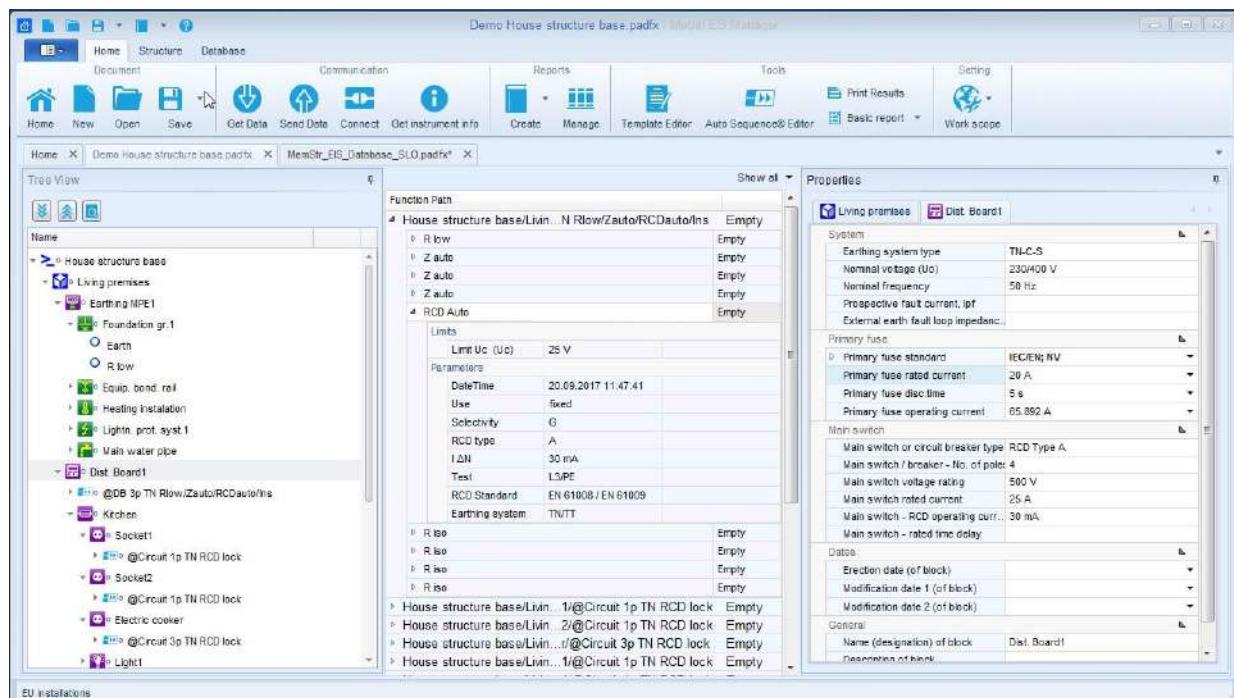

Obr. 2.1: Hlavné okno

Hlavné vlastnosti užívateľského rozhrania:

- Hlavné okno umožňuje rýchly výber prvkov štruktúry a údajov testu použitím stromového zobrazenia (je podobné Prieskumníkovi vo Windows).
- Vlastnosti vybraných prvkov štruktúry a údajov testu sú stále zobrazené v na to určených poliach hlavného okna.
- Užívateľ si môže prispôsobiť jednotlivé polia v hlavnom okne (zmenou veľkosti, presúvaním).

2.1.2 Konektivita

- Podporuje súčasné otvorenie viacnásobných projektov pre rôzne meracie prístroje.
- Podpora komunikácie USB a RS-232.



Poznámka

Prosím majte na mysli, že niektoré časti programu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia v rámci nových verzií, a preto sa líšiť od informácií uvedených v tomto návode. Ak na takéto rozdiely narazíte, budeme radi, ak nás o nich budete informovať emailom. Vaše príponky sa pokúsime zapracovať do najbližšej aktualizácie.

3 Súhlas s licenčnými podmienkami

3.1 Dôležité upozornenie

Pred použitím programu si pozorne prečítajte licenčné podmienky. AKÝMKOĽVEK POUŽITÍM TOHTO PROGRAMU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI LICENČNÉ PODMIENKY PREČÍTALI, POROZUMELI IM A SÚHLASÍTE S NIMI. AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, PROGRAM VÔBEC NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO ALEBO VYMAŽTE VŠETKY KÓPIE PROGRAMU ZO SVOJHO ZARIADENIA.

3.1.1 Udelenie licencie

Nainštalovaním programu (ďalej "Program") prijímate nasledujúcu Licenčnú zmluvu.

LICENČNÁ ZMLUVA. Toto je zákonná zmluva medzi vami (individuálnou osobou alebo organizáciou) a spoločnosťou d Metrel d.d.. Nainštalovaním Programu súhlasíte s tým, že ste viazaní jednotlivými článkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte, nenaninštalovaný Program urýchlene vráťte tam, kde ste ho zakúpili.

UDELENIE LICENCIE. Metrel d.d. vám udeľuje nevýhradnú licenciu pre používanie tohto Programu nižšie popísaným spôsobom. Práva udelené touto zmluvou sú platné len po zaplatení licenčných poplatkov. Program je licencovaný, nie predávaný.

1. COPYRIGHT. Program je vlastníctvom Metrel d.d. a je chránený medzinárodnými autorskými zákonmi. Toto musíte brať pri zaobchádzaní s Programom do úvahy. Môžete (a) vytvoriť jednu kópiu Programu pre potreby archivácie; (b) preniesť Program na jeden hard disk za predpokladu, že originál si ponecháte pre záložné účely; alebo (c) môžete Program uložiť alebo nainštalovať do pamäťového zariadenia, napríklad sieťového servera, ktorý sa používa len k inštalácii alebo spusteniu Programu na iných počítačoch v internej sieti za predpokladu, že získate a vyhradíte licenciu pre každý jeden počítač, na ktorom je Program nainštalovaný alebo spúšťaný. Licencia k Programu neoprávňuje k zdieľaniu a používaniu súbežne na viacerých počítačoch.
2. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK. OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE, PROGRAM JE POSKYTOVANÝ "TAK AKO JE", BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VÝSLOVNE UVEDENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, BEZ OBMEDZENÍ, ZÁRUK, POVINNOSTÍ ALEBO PODMIENOK VZŤAHUJÚCICH SA K OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA PRE AKÝKOĽVEK ÚCEL. Každý príjemca je samostatne zodpovedný za určenie vhodnosti použitia a distribúcie Programu a preberá všetky s tým spojené riziká, vrátane (ale nie len) rizík za chyby Programu, kompatibilitu s legislatívou, poškodenie alebo stratou údajov, programov a zariadení, a nedostupnosť alebo prerušenia činnosti.
3. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI. OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE, NENESIE VÝROBCA ANI ŽIADNY JEJ PREDAJCA NIJAKÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME ALEBO NEPRIAME, NÁHODNÉ ČI EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S FUNGOVANÍM PROGRAMU, JEHO DISTRIBÚCIOU ALEBO PREKÁŽKAMI V POUŽÍVANÍ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE DODÁVATEĽ PROGRAMU BOL NA TAKÚ MOŽNOSŤ UPOZORNENÝ.

4 Inštalácia programu

4.1 Systémové požiadavky

Pred inštaláciou sa uistite , že váš systém splňa nasledujúce požiadavky:

Podporované operačné systémy:

- Windows 7, 32-bit & 64-bit
- Windows 8, a 8.1, 32-bit & 64-bit
- Windows 10, 32-bit & 64-bit

Inštalovaná operačná pamäť (RAM):

- Windows 7: min. 2 GB (odporúčané 4 GB)
- Windows 8 and 8.1: min. 2 GB (odporúčané 4 GB)
- Windows 10, 2 GB (odporúčané 4 GB)

Priestor na pevnom disku:


- Najmenej 400 MB voľného miesta pre inštalačné súbory a dokumentáciu.
- Ďalších 280 MB (x86) alebo 610 MB (x64) voľného miesta, ak nie je nainštalovaný Microsoft.NET Framework (4.0 alebo vyšší).
- Ďalší priestor na disku (odporúčané 20 GB) je potrebný pre stiahnutie a uloženie dátových súborov ES Manager (jeden súbor môže mať veľkosť až 8 GB). Ďalsie miesto (odporúčané 20GB) je potrebné pre sťahovanie a ukladanie údajov ES Manager.

4.2 Inštalácia programu

Pre nainštalovanie programu spusťte z CD aplikáciu `Setup.exe`. Druhou možnosťou je stiahnutie programu zo sekcie Metrel Download. Inštaláciou vás bude viest' Sprievodca inštaláciou.


4.3 Aktualizácie programu

Nové aktualizácie sú zisťované automaticky, je však potrebné pripojenie k internetu. Ak je dostupná nová aktualizácia, táto informácia sa zobrazí v pravej spodnej časti obrazovky pri každom spustení programu. Inštalácia aktualizácie je možná po kliknutí na zobrazený link.

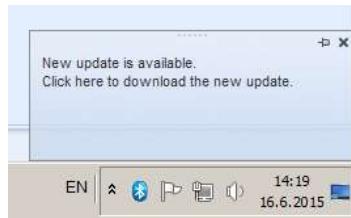

Obr. 4.1: Správa o dostupnej aktualizácii

Prístup k aktualizácii je tiež možný cez okno O programe. Podrobnosti o verzii programu (nové vlastnosti, opravené chyby, ...) sú dostupné v Poznámkach.

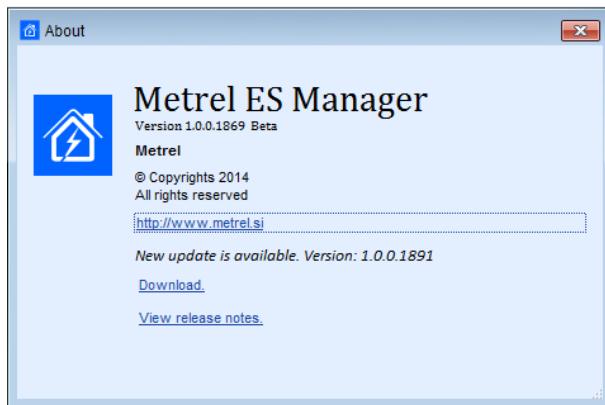

Obr. 4.2: Okno O programe

5 Začíname

5.1 Rýchle príručky a sprievodcovia

5.1.1 Úvodné príručky

Pred používaním programu Metrel ES Manager sú tu uvedené niektoré základné informácie. Nasledujúca časť vysvetľuje spôsob, ako sú v programe organizované údaje a ako s nimi efektívne pracovať.


- [Položky užívateľského rozhrania](#)
- [Vytvorenie štruktúry údajov](#)
- [Komunikácia s prístrojom](#)
- [Tlač výsledkov](#)
- [Správy z merania](#)
- [Spravovanie protokolov](#)
- [Šablóny protokolov](#)
- [Riešenie problémov](#)

6 Položky užívateľského rozhrania

6.1 Úvod

Po zapnutí programu sa zobrazí úvodné okno, ktoré v hornej časti obsahuje lištu s ponukou Menu (1), pracovnou plochou (2). Po pripojení k internetu prebehne kontrola dostupnosti aktualizácie (3).

Predvolený pracovný rámec je zobrazený v ľavom dolnom rohu (4). Skontrolujte jeho správnosť pred spustením nového súboru údajov. Po otvorení existujúcich údajov je pracovný rámec nastavený automaticky.

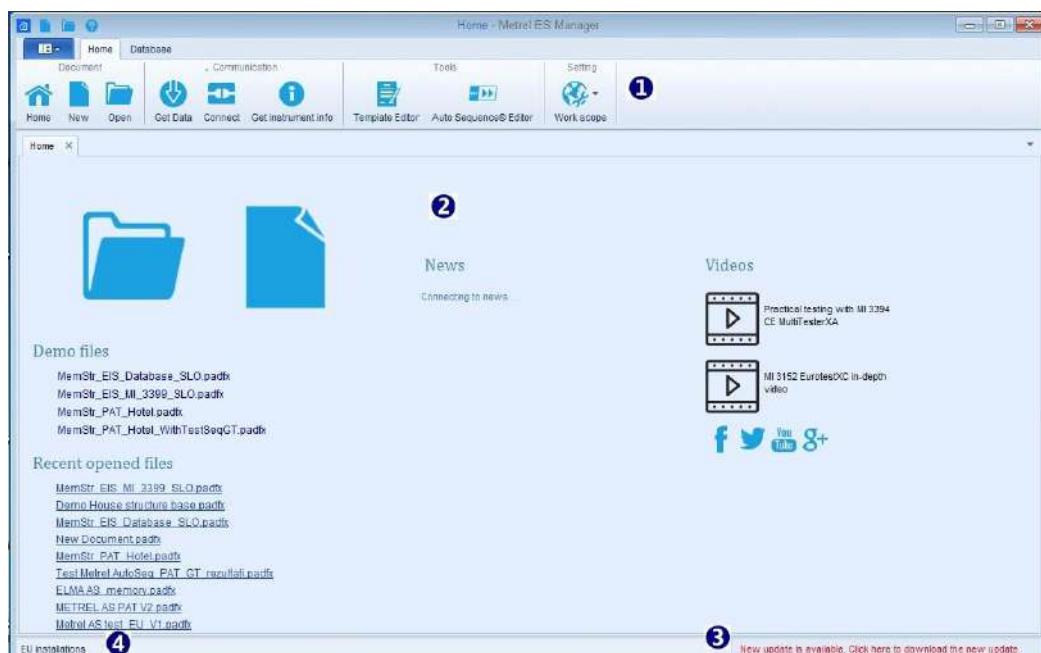

Obr. 6.1: Úvodné okno programu Metrel ES Manager


Dostupné možnosti:

- : Otvorí existujúci alebo nový súbor údajov
- **Demo súbory**: Otvorí vložený demo súbor zo zoznamu
- **Nedávno otvorené súbory**: Otvorenie súboru zo zoznamu
- **Správy**: Zobrazí nové informácie od Metrelu
- **Videá**: Prezeranie videí na YouTube kanáli Metrel
- : Prístup ku sociálnym médiám Metrel

6.2 Ponuka Menu

Ponuky Menu sú organizované v tabuľkovom štýle (pozrite Obr. 6.2). Každá ponuka menu otvorí sadu funkcií:


- **Domov** je predvolené, ponúka správu údajových súborov, reportov, komunikácie s prístrojmi, nastavenie pracovného rámca a prístup k ďalším nástrojom.
- **Štruktúra** poskytuje Prvky štruktúry a Merania pre vytvorenie zákazníckej (vlastnej) štruktúry pre testovanie.
- **Databáza** ponúka organizovanie údajov o zákazníkoch a prispôsobenie názvu štruktúry.
- **Hlavné** menu zobrazuje údaje o verzii programu a súbor Help. Poskytuje tiež funkcie Import, Export a zlúčenie dátových súborov. Pred začiatkom práce je dobre skontrolovať Nastavenia.



Obr. 6.2: Ponuka Menu

6.2.1 Funkcie hlavného menu

Po vybratí hlavného menu sa rozbalí ponuka s funkciami. Niektoré funkcie sú dostupné aj z menu Domov (práca s dokumentmi a tvorba reportu), ostatné sú dostupné len z ponuky Hlavného menu.

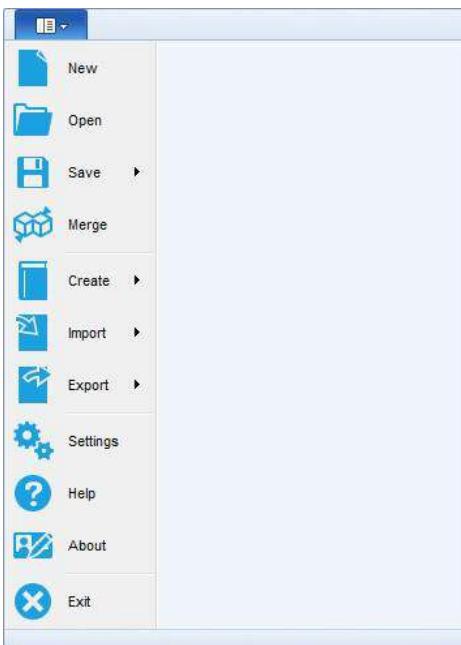

Obr. 6.3: Ponuka Hlavné menu

Špecifické funkcie hlavného menu:


-  **Merge** (Zlúčit): Spojí dva súbory s dátovými štruktúrami do jedného súboru. Užívateľ si môže vybrať hlavný a cieľový súbor. Všetky údaje sa zlúčia, zhodné položky v cieľovom súbore sú prepísané položkami z hlavného súboru.
-  **Import**: Importovanie údajov z predchádzajúcej generácie software pre správu údajov;
Možnosti:
Import: Import súborov údajovej štruktúry Euro Link PRO (EUL súbory pre prístroje EurotestXE)
Import len štruktúry: Import samotnej štruktúry zo súborov EUL (prístroje EurotestXA)
Import z PAT Link PRO: Import dátových súborov exportovaných z PATLink PRO
Import z aPAT: Import dátových súborov exportovaných z android aplikácie aPAT

-  **Export** : Exportovanie údajov do formátu Excel alebo XML;
Možnosti:
ToExcel Basic EIS export: exportuje štruktúru inštalácií a údaje testu do tabuľky Excel
ToExcel Basic PAT export: exportuje štruktúru, údaje testu a údaje o spotrebiči do tabuľky Excel
ToXML Basic EIS export: exportuje štruktúru inštalácií a údaje testu do súboru XML
ToXML Basic PAT export: exportuje štruktúru, údaje testu a údaje o spotrebiči do súboru XML
Pro Export: Licencované, zákazníkom definované testovacie štruktúry vyexportuje do súboru Excel. Dostupné len ak bol test vykonaný na prístroji s zodpovedajúcou licenciou. Pre viac info pozrite časť 10.3 Pro export do súborov Excel.

-  **Settings** (Nastavenia) Otvorí menu pre všeobecné nastavenia, jazyk, spravovanie licencii a hlavičky na tlač. Pre viac info pozrite kapitolu 6.2.1.1 Nastavenia.
-  **Help** : Otvorí menu pre nápovedu (vo formáte pdf).
-  **About** : Informácia o verzii programu Metrel ES Manager a kontrola dostupných aktualizácií.
-  **Exit** : Ukončenie programu.

6.2.1.1 Menu Nastavenia

Toto menu je organizované formou tabuľiek (záložiek):..

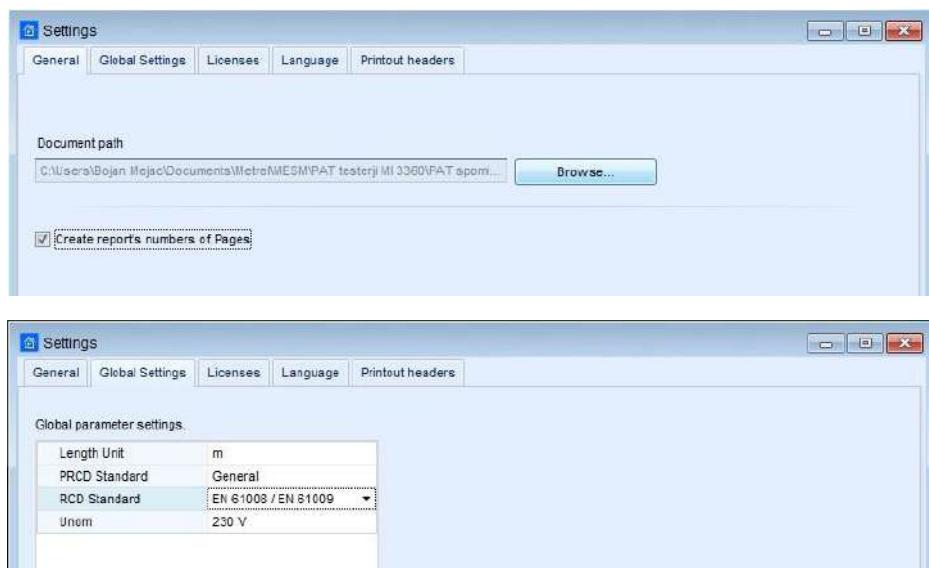

Obr. 6.4: Príklad menu Nastavenia

Všeobecné

Nastavenie predvoleného priečinku pre dokumenty Metrel ES Manager. Pre výber použite prehliadač, potom potvrďte.

Táto predvolená cesta je ponúkaná pri každej práci s dokumentmi (Ulož, Ulož ako, Otvoríť). Priečinok je tiež ponúkaný pri aktivácii nástroja Nadchádzajúce testy.

Možnosti: Vytvorenie počtu stránok report; nechajte odškrtnuté, ak požadujete manuálne číslovanie.

Celkové nastavenia

Prezerať aktuálnych nastavení. V prípade potreby je možné ich zmeniť výberom z ponuky, potvrdiť.


Licencie

Pre aktiváciu funkcií programu ES Manager prináležiacich ku konkrétnemu meraciemu prístroju je potrebné vložiť výrobné číslo prístroja a priradený licenčný kľúč.

Tieto údaje sú zobrazené v okne:

Možnosti:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| Serial Number | <input type="text"/> | : Pole pre manuálne vloženie výrobného čísla prístroja |
| License Key | <input type="text"/> | : Pole pre manuálne vloženie priradeného licenčného kľúča |
| <input type="button" value="Add"/> | | : Manuálne vloženie do zoznamu |
| <input type="button" value="Import license from File"/> | | : Otvorí prehliadač pre vloženie licenčného kľúča zo súboru; vyberte priečinok s uloženým licenčným súborom (*.lic), a otvorte ho. |
| <input type="button" value="Export licenses to File"/> | | : Otvorí prehliadač pre exportovanie zvoleného licenčného kľúča do súboru; pomenujte súbor, vyberte umiestnenie v PC a potvrďte Uložiť. |
| <input type="button" value="Synchronize licenses"/> | | : Synchronizácia licenčných kľúčov s pripojeným prístrojom. |

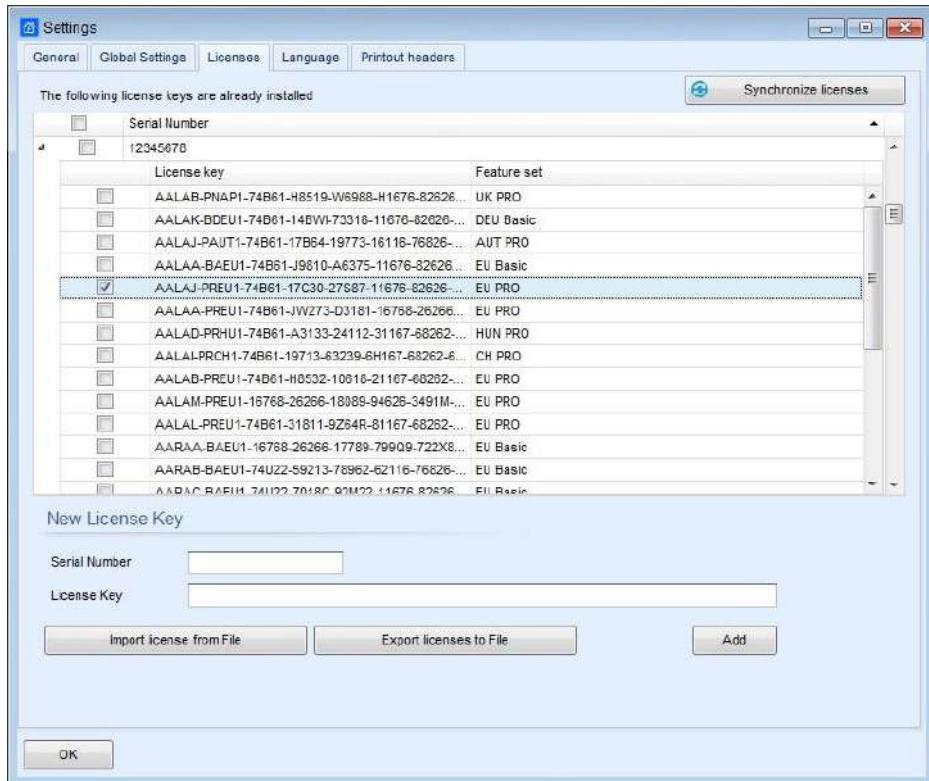

Obr. 6.5: Licencie

Poznámka:

Základný licenčný kľúč (Basic) ponúka limitované spravovanie profesionálnych reportov – možno ich vyplniť stiahnutými údajmi, ale tlač je zablokovaná.

Rozšírená licencia (PRO) ponúka plnú funkčnosť priradených profesionálnych reportov.

Jazyk

English (United Kingdom) : Aktuálne zvolený jazyk označený modrým bodom. Vyberte požadovaný jazyk. Novozvolený jazyk sa uplatní až po reštarte programu.


Hlavička na tlač

Užívateľ môže vložiť vlastné logo a textový obsah, budú sa tlačiť v hlavičke dokumentu. Zvlášť pre funkciu Tlač výsledkov a funkciu Basic report dostupné z hlavného okna.

6.2.2 Záložka Domov

Ponuka obsahuje možnosti:

- Dokument
- Komunikácia
- Správy (reporty)
- Nástroje
- Nastavenie

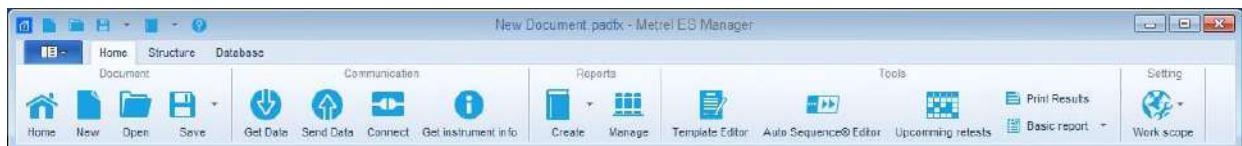

Obr. 6.6: Ponuka Domov

Menu Dokument

- **Home** : Navigácia do úvodného okna.
- **New** : Vytvorí nový prázdný dokument/databázu ES Manager.
- **Open** : Otvorí existujúci dokument ES Manager pre analýzu a editovanie.
- **Save** : Uloží dokument/databázu ES Manager.

Možnosti:

Uložiť – Uloží aktuálny dokumentový súbor ES Manager na disk. Ak súbor ešte neboli uložený (údaje stiahnuté z prístroja, alebo užívateľom vytvorený nový súbor), užívateľ bude vyzvaný na výber umiestnenia a názvu súboru.

Uložiť ako – Súbor bude uložený pod iným názvom. Užívateľ bude vyzvaný na výber umiestnenia a názvu súboru.

Komunikácia

Menu komunikácia obsahuje príkazy pre stiahnutie údajov z prístroja, alebo ich odoslanie do prístroja.

- **GetData** : Získa údaje z prístroja.
- **Send Data** : Odošle údaje do prístroja.
- **Get instrument info** : Zobrazí základné údaje o pripojenom meracom prístroji. Ak je dostupné pripojenie na internet, zobrazí sa aj prípadná ponuka na aktualizáciu firmware prístroja.
- **Connect** : Otvorí okno pre spravovanie prenosu údajov medzi pripojeným prístrojom a PC.

Reporty (Správy)

Ponuka Správy je dostupná len ak je otvorený súbor s údajmi.



- **Create** (Vytvorit): Otvorí zoznam formulárov pre vytvorenie Správy.

Možnosti:

Vytvoriť správu: Vytvorí správu založenú na zvolenom formulári

Vytvoriť zo šablóny: Vytvorí správu založenú na súbore šablóny (*.rtmpl); užívateľ je vyzvaný na nastavenie ‘Date Filter’ pred otvorením testov vykonaných v určitom časovom období.



- **Manage** (Spravovať): Otvorí zoznam existujúcich správ založených na aktuálne zvolenom dátovom súbore.

Nástroje



- **Template Editor** (Editor šablóny): Otvorí prehliadač pre navigáciu k priečinku so šablónovými súbormi v PC. Zvolený súbor (*.rtmpl) sa otvorí v Editore správ.



- **Upcomming retests** (Nadchádzajúce testy): Otvorí okno pre spravovanie naplánovaných opakovaných testov pre testovanie elektrických spotrebičov a náradia.

Poznámka: Cesta pre súbor by mala byť nastavená vopred (pozrite časť 6.2.1.1 Menu Nastavenia); Editor naplánovaných testov automaticky vyhľadá spotrebiče uložené v nastavenom umiestnení.



- **Print Results** (Tlačiť výsledky): Otvorí report výsledkov v náhľadovom okne. Pred tlačou (alebo exportom do pdf alebo obrázku) je možná úprava stránky.



- **Basic report** (Základný report): Otvorí kompaktnú šablónu reportu výsledkov v náhľadovom okne. Pred tlačou (alebo exportom do pdf alebo obrázku) je možná úprava stránky.
Možnosti: ‘Filtrovaný základný report’ umožňuje nastaviť dátový filter pre aktuálne výsledky.



- **Auto Sequence® Editor:** Nástroj pre programovanie automatizovaných testovacích postupností Auto Sequence®. Pre viac info pozrite návod na obsluhu ku konkrétnemu prístroju.

Menu Nastavenie




- **Work scope** (Pracovný rámec): Z rozbalovacieho menu vyberte typ práce.

6.2.3 Funkcie záložky Štruktúra

Záložka Štruktúra ponúka prvky štruktúry, merania a nevyhnutné editovacie príkazy na vytvorenie zákazníckej stromovej štruktúry testovaného objektu. Sú dostupné tieto skupiny funkcií:

- Editovanie
- Štruktúra
- Merania

Prvky stromovej štruktúry môžu obsahovať naplánované merania. Prvky štruktúry dostupné zo skupiny Štruktúra, a testy dostupné zo skupiny Merania závisia na zvolenom Pracovnom rámci.

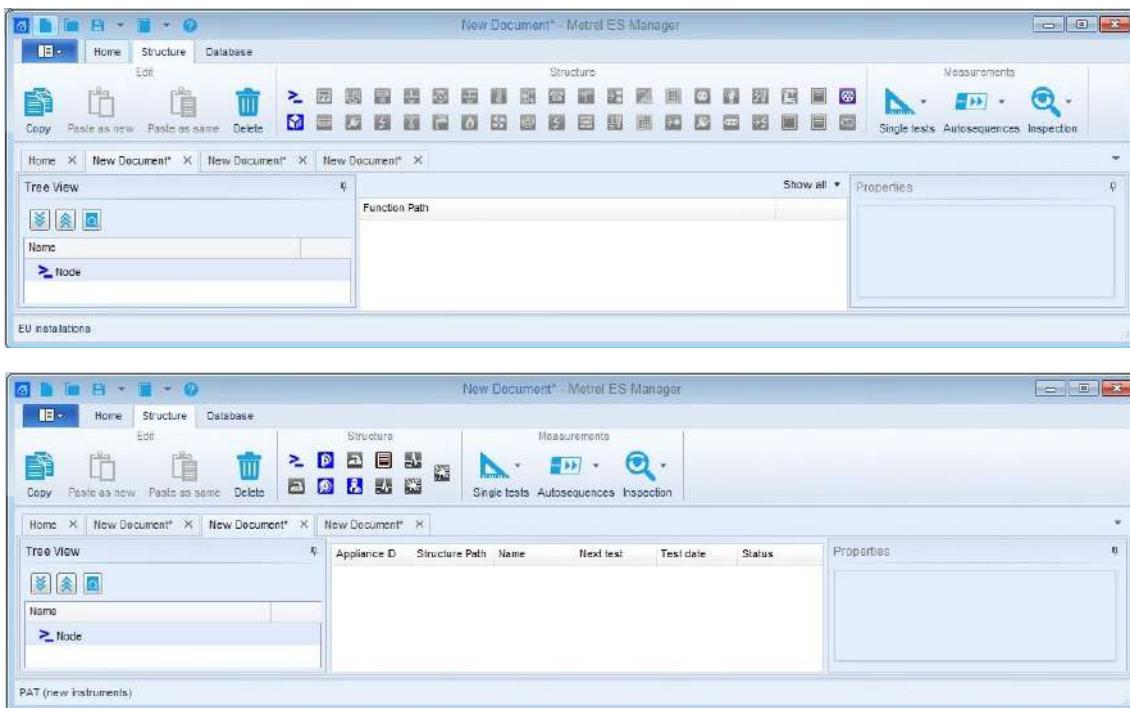


Obr. 6.7: Tabuľky štruktúry – Pracovný rámec Inštalácie a Test spotrebičov

Menu Editovanie

Toto menu obsahuje základné príkazy pre editáciu. Kliknutím na ikonu sa príkaz vykoná na vybranom prvku štruktúry. Kliknutím pravým tlačidlom myši na prvok štruktúry sa zobrazí menu s ponukou príkazov. (Obr. 6.8.)

Ponuka menu závisí od typu zvoleného uzlu.



- **Copy** (Kopírovať): Do dočasnej pamäte sa skopíruje vybraný prvok štruktúry spolu so všetkými podprvkami a priradenými meraniami.



- **Paste as new** (Vložit' ako nové): Vloží údaje z dočasnej pamäte do zvoleného prvku štruktúry. Výsledky merania nie sú zahrnuté. Merania sú vložené ako nové prázdne merania. Príkaz je neaktívny, ak nič nebolo skopírované, alebo ak vybraný prvok neumožňuje vloženie.




Paste as same

- (Vložiť ako zhodný): Vloží údaje z dočasnej pamäte do zvoleného prvku štruktúry. V rámci toho istého súboru sa súbor vykoná ako Vložiť ako nové; duplikácia unikátnych súborov nie je dovolená v rámci toho istého súboru. Príkaz je neaktívny, ak nič nebolo skopírované, alebo ak vybraný prvok neumožňuje vloženie.



Delete

- (Vymazat’): Vymaže zvolený prvok štruktúry spolu so všetkými podprvkami a meraniami.

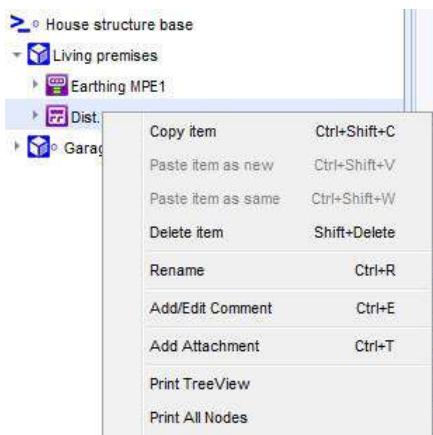


Obr. 6.8: Menu s príkazmi (po kliknutí pravým tlačidlom myši)

Menu Štruktúra

Menu Štruktúra obsahuje všetky prvky štruktúry pre vytvorenie zákazníckej štruktúry pre testovanie na mieste. Typ prvkov závisí na nastavenom Pracovnom rámcu (**Obr. 6.9**). Kliknutím na prvok je tento vložený do stromu štruktúry.

Prvky štruktúry sú usporiadané v hierarchických vzťahoch. Rodičovský (aktuálne zvolený) prvok určuje, ktoré prvky môžu byť vložené ako detské prvky – tieto prvky sú v ponuke zvýraznené. Umiestnením ukazovateľa myši na prvok sa zobrazí jeho názov a popis.

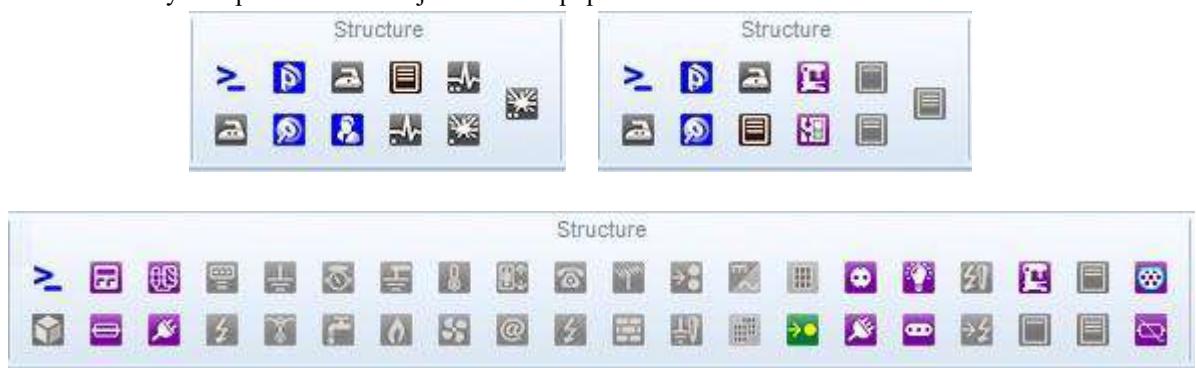

Obr. 6.9: Prvky štruktúry pre rôzne Pracovné rámce.

Menu merania

Menu obsahuje nástroje pre priradenie Jednotlivých testov, Autosekvencií a Kontrol ku jednotlivým prvkom štruktúry. Ponuka meraní závisí od použitého Pracovného rámca.



- **Single tests**: (Jednotlivé testy): Otvorí zoznam dostupných jednotlivých testov, vyberte z rozbaľovacieho menu. Nastavte parameter, limity a potvrďte. Test sa priradí k vybranému prvku štruktúry.



- **Autosequences**: Otvorí zoznam dostupných testov Autosequence®, ak bol predtým otvorený súbor so skupinami Autosequence® (*.atmpx). Test sa ku prvku priradí dvojklikom.

Možnosti:

Vyhľadanie súboru so skupinami Autotestov: Otvorte prehliadač v umiestnení priečinku so súborom skupín Autotestov; vyberte jeden a potvrďte výber, otvorí sa. Existujúci súbor bude nahradený týmto novým. Toto menu je dostupné kliknutím na trojuholník vo vnútri tlačidla.

Poznámka: Súčasne môže byť otvorený len jeden súbor so skupinami Autosequence®.



- **Inspection**: (Kontrola): Otvorí zoznam dostupných kontrol, vyberte jednu z ponuky. Otvorí sa jej okno, potvrďte výber. Kontrola sa priradí k zvolenému prvku štruktúry v rámci stromu štruktúry.

6.2.4 Záložka Databáza

Často používané údaje môžu byť zapísané do tabuľiek, ktoré sú k dispozícii v záložke Databáza. Tieto údaje možno potom priradiť k prvkom štruktúry, alebo do hlavičky pre tlač výsledkov (pozrite Nastavenia / Hlavička na tlač). Vzhľad ponuky v záložke Databáza (**Obr. 6.10**) závisí od nastaveného Pracovného rámca. Hlavné položky sú:

- Kontakty
- Názvy štruktúr
- Zoznamy zákazníkov (len pre Pracovný rámec Bezpečnosť spotrebičov I / II)

	Organization	Name	Address	Telephone	Mobile	Fax	Email	Client number	Postcode
Seaside hotel chain	Beach hotel	Sunny street 10		071717171			info@beachh...	100	1000
Seaside hotel chain	Lagune hotel	Lagune street...		071171717			info@laguneh...	101	1001

**Obr. 6.10: Záložka Databáza – je zvolená položka Klient v skupine Kontakty
Položka Kontakty**

Tabuľka obsahuje stĺpce pre údaje zákazníka (Organizácia, Meno, Adresa, Telefón, Email atď), ktoré možno priradiť k prvkom štruktúry jednoduchým vybraním z rozbaľovacieho zoznamu. Všeobecné (pre všetky nastavenia Pracovného rámca) sú:

- Klient (položka Klient / PAT testovanie, položka Lokalita / Test inštalácií)
- Adresy (položka Lokalita / Test inštalácií, Hlavička tlače výsledkov)
- Zodpovedná osoba (položka Lokalita / Test inštalácií, Hlavička tlače výsledkov)

Navyše len pre PAT testovanie (Testovanie spotrebičov):

- Adresa umiestnenia (položka Lokalita / PAT testovanie)

Možnosti úprav:


-  **Clear** (Vyčistiť): Odstráni všetky údaje zo zvoleného zoznamu.
-  **Delete row** (Vymazať riadok): Odstráni zvolený riadok zo zoznamu

Položka Názvy štruktúry

Ide o fixný zoznam Prvkov, ktoré môžu byť použité na vytvorenie zákazníckej stromovej štruktúry testovaného objektu (**Obr. 6.11**). Užívateľ môže prispôsobiť názov Prvku pod ktorým je prezentovaný v stromovej štruktúre. Zobrazené prvky závisia od zvoleného Pracovného rámca.

Názvy štruktúry obsahujú údajové stĺpce:

- **Obrázok:** Grafická prezentácia prvku
- **Predvolený názov:** Predvolený názov v Metrel ES Manager
- **Zákaznícky názov:** Užívateľom definovaný názov prvku (kliknite na názov a upravte ho).

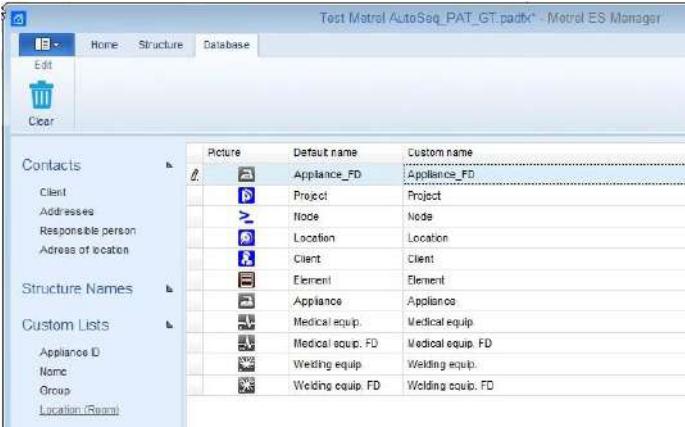

	Picture	Default name	Custom name
Appliance_FD		Appliance_FD	Appliance_FD
Project		Project	Project
Node		Node	Node
Location		Location	Location
Client		Client	Client
Element		Element	Element
Appliance		Appliance	Appliance
Medical equip.		Medical equip.	Medical equip.
Medical equip. FD		Medical equip. FD	Medical equip. FD
Welding equip.		Welding equip.	Welding equip.
Welding equip. FD		Welding equip. FD	Welding equip. FD

Obr. 6.11: Názvy štruktúry

Možnosti úprav:

-  **Clear** (Vyčistiť): Po upozornení a potvrdení budú všetky zákaznícke názvy nastavené do (pôvodného) predvoleného stavu.


Poznámka:

Zákaznícky názov je vždy použitý na prvok v rámci stromovej štruktúry. Originálne je zákaznícky názov vždy zhodný s predvoleným názvom.

Zákaznícke zoznamy

Ked' je Pracovný rámcu nastavený na Testovanie bezpečnosti elektrických zariadení, k dispozícii sú ďalšie zákaznícke zoznamy (**Obr. 6.12**). Sú určené pre vloženie často používaných údajov o testovanom objekte, ktoré by mohli byť pripojené k prvkom štruktúry prezentujúcich elektrické zariadenie, a to len jednoduchým výberom z rozbaľovacieho menu:

- **Appliance ID** (predvolený je prázdný zoznam)
- **Name**: názov elektrického zariadenia (predvolene je už čiastočne vyplnený, užívateľ môže pridať nové názvy)
- **Group**: názov skupiny zariadení (predvolene je už čiastočne vyplnený, užívateľ môže pridať nové názvy)
- **Location (Room)**: názov umiestnenia (predvolený je prázdný zoznam)

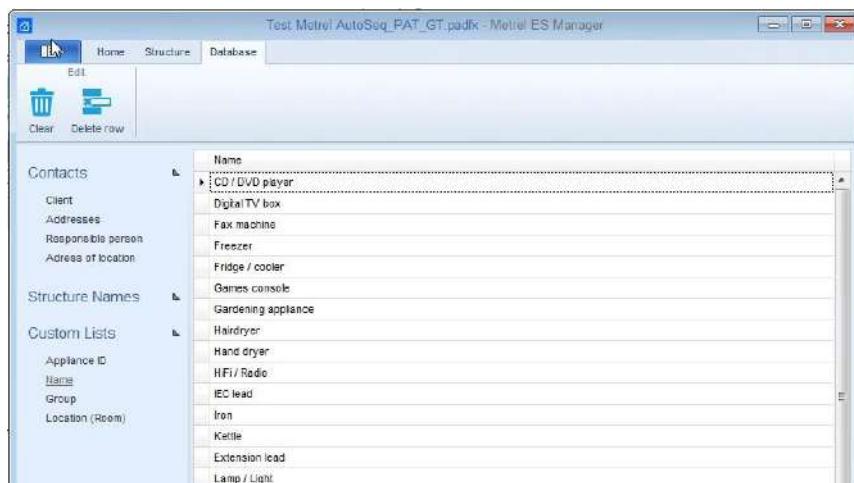

Obr. 6.12: Zákaznícky zoznam


Možnosti:

-  : Zvolený zoznam sa obnoví do predvolených nastavení, zákazníkom vložené informácie sa vymažú.
-  : Zo zoznamu sa vymaže zvolený riadok.

6.3 Pracovná plocha programu

Užívateľská pracovná plocha je zobrazená nižšie na **Obr. 6.13**. Súčasne môžu byť otvorené viaceré dátové súbory, nezávisle na ich Pracovnom rámcu. Ich názvy sú zobrazené v časti **❶**, aktívny súbor je zvýraznený. Obsah súboru je prezentovaný v troch hlavných plochách:

- **Stromový pohľad (❷)**
- **Výsledky (❸)**
- **Vlastnosti (❹)**

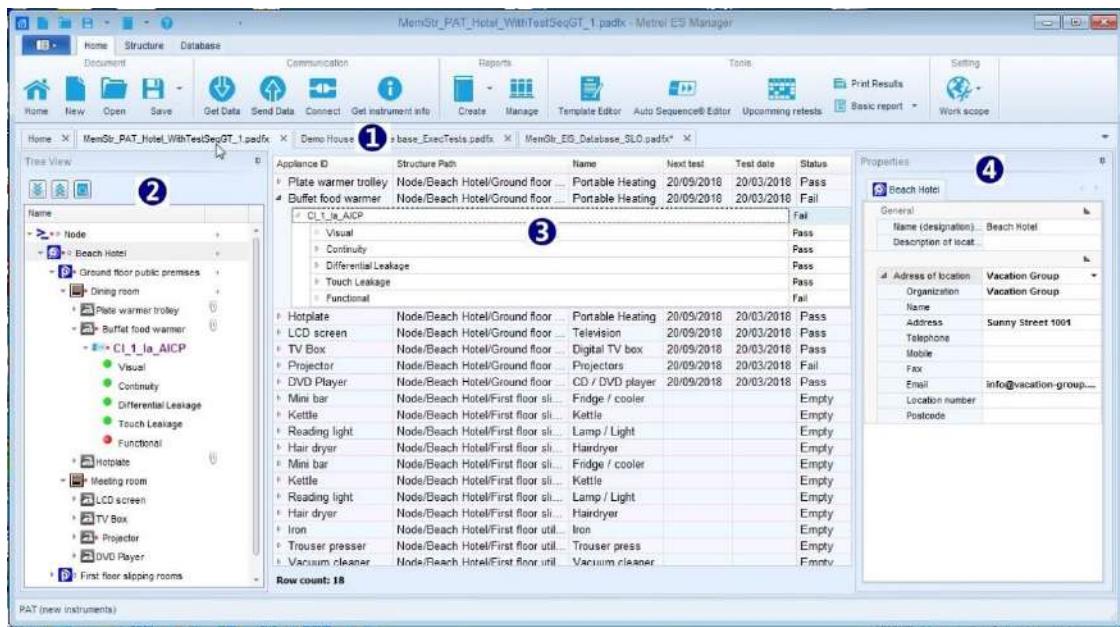

Obr. 6.13: Pracovná plocha

6.3.1 Spravovanie pracovnej plochy

Okno s výsledkami je vždy v centre pracovnej plochy a správa sa ako hlavné (rodičovské) okno, ku ktorému sú pripojené okná so Stromovým pohľadom a Vlastnosťami. Vždy keď je dátový súbor otvorený alebo stiahnutý z prístroja, sú ku nemu z ľavej a pravej strany pripojené tieto dve okná. Užívateľ môže meniť vzhľad pracovnej plochy:

- Upraviť šírku okien so stromovým pohľadom a vlastnosťami:** umiestnite ukazovateľ myši na okraj okna, zobrazia sa šípky (→←), stlačte ľavé tlačidlo myši a potiahnite doľava alebo doprava.
- Skrýť okná so stromovým pohľadom a vlastnosťami:** kliknite ľavým na tlačidlo pripievnenia (⊕) umiestnenom v ľavom hornom rohu okna, okno sa uvoľní. Na boku sa objaví vertikálny pás s názvom okna (pre stromový pohľad vľavo, pre vlastnosti vpravo), pozrite (1) a (2) na Obr. 6.14. Klikaním na tento pás sa príslušné okno zobrazí alebo skryje. Po kliknutí na (⊖) sa okno opäť pripojí k strednému hlavnému oknu..
- Meniť veľkosť okna s výsledkami:** umiestnite ukazovateľ myši na hranu na ľavej strane, zobrazia sa šípky (→←), a ľavým stlačením potiahnite doľava alebo doprava.

Poznámka:

Okno s výsledkami je vždy roztahnuté medzi oknom so stromovým pohľadom a oknom s vlastnosťami. Ak sa niektoré z týchto dvoch okien stiahne na vertikálny pás na okraji, okno s výsledkami sa adekvátnie roztahne.

The screenshot shows the Memet EG Manager interface. On the left, there's a tree view of devices under 'Appliance ID'. A node labeled 'C_U_1_ACP' is expanded, showing various functional tests like Visual, Continuity, Differential Leakage, Touch Leakage, and Functional. To the right is a table of test results:

Appliance ID	Structure Path	Name	Next test	Test date	Status
Plate warmer trolley	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Dining ro...	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Pass
Duftel food warmer	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Dining ro...	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Fail
C_U_1_ACP					Fail
Visual					Pass
Continuity					Pass
Differential Leakage					Pass
Touch Leakage					Pass
Functional					Fail
mechanical operation					Pass
electrical operation					Pass
safety relevant functions					Fail
Hotplate	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Dining ro...	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Pass
LCD screen	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Meeting ro...	Television	20/09/2018	20/03/2018	Pass
TV Box	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Meeting ro...	Digital TV box	20/09/2018	20/03/2018	Pass
Projector	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Meeting ro...	Projectors	20/09/2018	20/03/2018	Fail
DVD Player	Node/Beach Hotel/Ground floor public premises/Meeting ro...	CD / DVD player	20/09/2018	20/03/2018	Pass
Mini bar	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 101/Mini...	Fridge / cooler			Empty
Kettle	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 101/Kettle	Kettle			Empty
Reading light	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 101/Rea...	Lamp / Light			Empty
Hair dryer	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 101/Bat...	Hairdryer			Empty
Mini bar	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 102/Mini...	Fridge / cooler			Empty
Kettle	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 102/Kettle	Kettle			Empty
Reading light	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 102/Rea...	Lamp / Light			Empty
Hair dryer	Node/Beach Hotel/First floor slipping rooms/Room 102/Bat...	Hairdryer			Empty
Row count: 18					

Obr. 6.14: Pracovná plocha so skrytými oknami Stromový pohľad a Vlastnosti

6.3.2 Možnosti Stromového pohľadu

Stromový pohľad (**Obr. 6.15**) umožňuje prezeranie štruktúry údajov a zobrazuje stav vykonaných meraní pridaním symbolov stavu merania k ikonám štruktúry.

Tlačidlá v hornej lište (❶):

- Rozbalí všetky uzly štruktúry
- Zbalí všetky uzly štruktúry
- Otvorí okno pre vyhľadávanie (❷) – slúži na zadanie textového reťazca. Všetky výsledky vyhľadávania sú v stromovom pohľade zvýraznené.

Trojuholníkové značky pred objektom na rozbalenie / zbalenie pod-stromových uzlov:

- Podstrom je zbalený, kliknutím na trojuholník (šípku) sa uzol rozbalí.
- Podstrom je rozbalený, kliknutím na trojuholník (šípku) sa uzol zbalí.

Pravým klikom na prvok štruktúry sa rozbalí menu s možnosťami (❸):

- Kopírovať položky, Vložiť položku ako novú, Vložiť položku ako zhodnú, Vymazať položku, Pomenovať:** Funkcie pre prácu s objektmi štruktúry a meraniami.
- Komentár vložiť / editovať:** Môžete napísť krátke komentár, ktorý sa zobrazí pod vybraným objektom (❹).
- Pridať prílohu:** K vybranému objektu je možné pridať prílohu. V stĺpci pre prílohy sa zobrazí symbol (❺). Prílohou môže byť obrázok, textový súbor a pod. Tento možno otvoriť, editovať alebo odstrániť. Kliknutím na oznámenie sa zobrazí zoznam príloh.

Poznámka:

Prílohy sú uložené len v aktuálnom dátovom súbore štruktúry, a nebudú odoslané do prístroja. Ak sa súbor štruktúry s prílohami pošle do prístroja potom sa opäť stiahne do nového súboru štruktúry, prílohy v novej štruktúre budú stratené.

- **Tlačiť Stromový pohľad:** Otvorí aktuálny stromový pohľad (iba vybrané uzly budú rozbalené) v okne na prezeranie. Náhľad obsahuje všetky štandardné funkcie pre editáciu súborov pre tlač – je možné upraviť hlavičku a päťu, nastaviť farbu pozadia. Tiež je možné editovaný dokument exportovať do súboru pdf.
- **Tlačiť všetky uzly:** Rozbalí všetky uzly a otvorí stromový pohľad v okne na prezeranie.
- **Údaje prístroja:** ide o údaje prístroja, ktorým bolo meranie vykonané. Dostupné len pre ukončené merania (jednotlivé testy alebo Auto Sequence®).



Obr. 6.15: Stromový pohľad

Indikácia stavu (statusu) testu objektu štruktúry

Status testov Autosequence® je indikovaný bodom za ikonou:

-  (prázdný bod): Prázdné (ešte nevykonané) meranie; kliknutím na trojuholník (šípku) pred ikonou sa rozbalí vetva a zobrazí sa obsah merania.
-  (červený bod): Vykonané meranie s nevyhovujúcim výsledkom; kliknutím na trojuholník (šípku) pred ikonou sa rozbalí vetva a zobrazí sa obsah merania.
-  (žiadny bod): Vykonané vyhovujúce meranie nemá žiadnu špeciálnu indikáciu; kliknutím na trojuholník (šípku) pred ikonou sa rozbalí vetva a zobrazí sa obsah merania.
-  : Objekt bez trojuholníkovej značky (šípky) vpredu nemá priradené žiadne meranie.
-  : Najmenej jedno meranie v rámci priradeného podstromu nevyhovelo.
-  Obsahuje ešte nevykonané merania, ako aj nevyhovujúce meranie.

Indikácia stavu (statusu) jednotlivého testu

Status merania je indikovaný krúžkom pred názvom jednotlivého testu.

-  : Vyhovujúce ukončené meranie s výsledkami testu, vykonané meracím prístrojom.
-  : Nevyhovujúce ukončené meranie s výsledkami testu, vykonané meracím prístrojom.
-  : Ukončené meranie s výsledkami testu bez statusu, vykonané meracím prístrojom.
-  : Prázdné meranie bez výsledkov testu.
-  : Virtuálne - Vyhovujúce ukončené meranie s manuálne pridanými výsledkami testu v SW.
-  : Virtuálne - Nevyhovujúce ukončené meranie s manuálne pridanými výsledkami testu v SW.
-  : Virtuálne - Ukončené meranie s manuálne pridanými výsledkami testu bez statusu, v SW.

6.3.3 Možnosti okna s výsledkami

Okno s výsledkami je určené pre detailný prehľad meraní spojených s prvkami údajovej štruktúry. Jeho vzhľad a možnosti závisia na nastavenom Pracovnom rámci (pre viac info pozrite časť 6.3.3.1).

Zobrazenie nameraných údajov (**Obr. 6.16**) je organizované v tabuľkovej forme, a obsahuje:

- **Cesta funkcie** – adresár v rámci stromovej štruktúry a priradený názov merania (❶). Ľavým kliknutím na trojuholník vpredu sa namerané údaje rozbalia (❷) alebo zbalia (❸).
- **Namerané údaje** s názvom testu, výsledkami, podvýsledkami, parametrami a nastavenými limitnými hodnotami (❹).
- **Status testu** (vyhovuje / nevyhovuje) (❺).
- **Dátum a čas merania** (❻).

Okno z výsledkami je naviazané na zvolený objekt v rámci stromového pohľadu; prezentujú sa výsledky spojené s pod-stromovou štruktúrou zvoleného objektu.

Filter nameraných údajov: zobrazené údaje možno filtrovať podľa rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu:

- **Show all ▾ (Ukáž všetko):** Zobrazia sa Výsledky, podvýsledky, Limity a Parametre.
- **Show results and subresults ▾ (Ukáž výsledky a podvýsledky):** Zobrazia sa len Výsledky a Podvýsledky.

Status merania je uvedený v príslušnom stĺpci:

- **Vyhovuje:** Vyhovujúce ukončené meranie s výsledkami testu.
- **Nevyhovuje:** Nevhovujúce ukončené meranie s výsledkami testu.
- **Nič:** Ukončené meranie s výsledkami testu a bez statusu.
- **Prázdne:** Prázdne meranie bez výsledkov testu.

Obr. 6.16: Okno s výsledkami

Po pravom kliknutí na cestu funkcie sa zobrazí ponuka príkazov:

- **Editovať:** editácia parametrov testu a limitov prázdneho merania
- **Tlačiť vybrané:** tlač výsledkov zvoleného objektu štruktúry.
- **Tlačiť všetko:** tlač výsledkov všetkých objektov štruktúry.
- **Rozbalíť všetko:** Rozbalí všetky Cesty funkcie na prezeranie nameraných údajov
- **Zbalíť všetko:** Zbalí všetky merania, takže zobrazené sú len Cesty funkcie.
- **Zobraziť grafy:** Otvorí okno pre grafickú prezentáciu nameraných výsledkov. Dostupné len pre merania obsahujúce grafy.

6.3.3.1 Okno s výsledkami pre Pracovný rámec Bezpečnosť spotrebičov

Ak je Pracovný rámec nastavený na Bezpečnosť prenosných spotrebičov, v okne s výsledkami sa zobrazia dodatočné stĺpce (**Obr. 6.17**):

- **Spotrebič ID:** identifikácia testovaného spotrebiča.
- **Cesta štruktúry:** Adresa spotrebiča vo vnútri stromovej štruktúry.
- **Názov:** Názov spotrebiča.
- **Nasledujúci test:** Dátum nasledujúceho testu podľa nastavenej periódy testovania.
- **Dátum testu:** Dátum testu z prístroja.
- **Stav:** Stav (status) testu

Tabuľka spotrebičov je naviazaná na zvolený objekt v rámci stromového pohľadu; prezentujú sa výsledky spojené s pod-stromovou štruktúrou zvoleného objektu.

Následne, po ľavom kliku na riadok v okne s výsledkami, rozbalí a zobrazí sa zodpovedajúca vetva Stromového pohľadu, zvolená položka je zvýraznená.

The screenshot shows a software interface for managing appliance tests. At the top, there is a table with columns: Appliance ID, Structure Path, Name, Next test, Test date, and Status. The table lists several appliances: DVD Player, Projector, TV Box, LCD screen, Hotplate, and Buffet food w... The last row, 'Buffet food w...', is expanded to show detailed test results for 'CL_1_Ia_AICP'. This expanded view includes sections for Visual, Continuity, Differential Leakage, Touch Leakage, Results, Limits, Parameters, Functional, and a summary section at the bottom. The 'Touch Leakage' section is currently active. The 'Functional' section shows a single entry with a status of 'Fail'. A message at the bottom left of the expanded view says 'Row count: 18'.

Obr. 6.17: Vzhľad okna s výsledkami pre testovanie spotrebičov

Poradie zoznamu v stĺpcí

Každý stĺpec tabuľky ponúka filter, aktivovaný ľavým klikom na názov stĺpca. Aktuálne filtrovanie je znázornené šípkou na ľavej strane poľa s názvom stĺpca (Test date). Filter poradia možno v jednom čase aplikovať len na jednom stĺpci. Ďalším kliknutím sa poradie zmení na opačné.

Filtrovanie údajov (Obr. 6.18)

Filter údajov možno použiť v rámci ktoréhokoľvek stĺpca, súčasne môže byť aplikovaných aj viac filtrov. Pravým kliknutím na názov okna sa zobrazí menu pre výber filtra:

- Custom filter (Zákaznícky filter): Pole pre zadanie filtra sa zobrazí nad tabuľkou (1)
- Row filter (Riadkový filter): Pole filtra sa zobrazí ako riadok hned pod názvami stĺpcov (2).
- Použitie kritériá filtrovania sú zobrazené v spodnej časti tabuľky (3):
 - Kliknutím na sa filter vypne, ďalším kliknutím sa zapne.
 - Kliknutím na sa filter zruší.
- Zákaznícky filter a Riadkový filter sú zhodné, líšia sa len v zadávacích poliach a postupe. Užívateľ si môže vybrať filter, ktorý mu viac vyhovuje. Nastavenia v týchto filtroch sa navzájom zrkadlia.

The screenshot shows a search interface with a filter panel at the top containing three conditions: [Status] Equals pass, [Next test] Equals 20/09/2018, and [Name] Contains Heating. A large blue circle labeled '1' is over the 'And' operator. Below the filter is a button 'Apply filter'. The main area is a table with columns: Appliance ID, Structure Path, Name, Next test, Test date, and Status. Two rows are shown: 'Plate warmer trolley' and 'Hotplate', both with 'Portable Heating' names and '20/09/2018' next test dates. The 'Test date' column shows '20/03/2018' and 'Pass' status respectively. A blue circle labeled '2' is over the 'Name' column header. At the bottom, a search bar contains the text '[Status] = 'pass' And [Next test] = '20/09/2018' And Contains([Name], 'Heating')' with a checked checkbox, and a blue circle labeled '3' is over the search bar.

Appliance ID	Structure Path	Name	Next test	Test date	Status
Plate warmer trolley	Node/Beach Hotel/Ground floor public area	Portable Heating	= 20/09/2018	= 20/03/2018	= pass
Hotplate	Node/Beach Hotel/Ground floor public area	Portable Heating	= 20/09/2018	= 20/03/2018	= pass

Obr. 6.18: Možnosti filtrovania pre test spotrebičov

Vyhľadávací filter v tabuľke spotrebičov

Pravým kliknutím na tabuľku sa zobrazí menu, z ktorého možno vybrať položku "Nájsť panel":

- (Nájsť panel): V hornej časti tabuľky sa zobrazí okno pre vyhľadávací filter (❶).
- (❷) Do poľa vpište požadovaný výraz, vyhľadávanie sa začne automaticky.
- (❸) Zobrazia sa položky obsahujúce zadaný retázec, zhodný výraz je zvýraznený.
- : (Vymazať filter): Odstráni filtrovanie a vymaže pole pre zadávanie

The screenshot shows a search interface with a search bar at the top containing the text 'heating' with a blue circle labeled '2' over it. To the right are buttons 'Find...' and 'Clear'. Below the search bar is a table with columns: Appliance ID, Structure Path, Name, Next test, Test date, and Status. Three rows are shown: 'Plate warmer trolley', 'Hotplate', and 'Buffet food warmer', all with 'Portable Heating' names and '20/09/2018' next test dates. The 'Test date' column shows '20/03/2018' and 'Pass' status respectively. A blue circle labeled '1' is over the 'Find...' button. A blue circle labeled '3' is over the table body.

Appliance ID	Structure Path	Name	Next test	Test date	Status
Plate warmer trolley	Node/Beach Hotel/Ground floor public area	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Pass
Hotplate	Node/Beach Hotel/Ground floor public area	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Pass
Buffet food warmer	Node/Beach Hotel/Ground floor public area	Portable Heating	20/09/2018	20/03/2018	Fail

Obr. 6.19: Pole pre vyhľadávanie

Príkazy tabuľky spotrebičov

Pravým kliknutím vo vnútri tabuľky spotrebičov sa ponúkne menu, z ktorého možno vyberať:


- (Vymazať filtre): Vymaže všetky filtre
- (Vymazať položku): Vymaže zvolenú položku
- (Vymazať všetko): Vymaže všetky položky z tabuľky

6.3.4 Možnosti okna Vlastnosti

Okno zobrazuje popis objektov umiestnených v strome projektu dátovej štruktúry. Vzhľad tohto okna závisí na nastavenom Pracovnom rámcu a vlastností priradených ku typu objektu.

Aktuálne zobrazenie okna (Obr. 6.20) je naviazané na objekt zvolený v stromovom pohľade:

- Vlastnosti zvoleného objektu a vlastnosti všetkých rodičovských objektov sú prezentované v samostatných tabuľkách v rámci pásu s tabuľkami (1). Aktívna je zvolená tabuľka. Kliknutím na záložku sa aktivuje požadovaná tabuľka. Medzi záložkami sa dá rolovať pomocou šípok.
- Zoznam priradených vlastností sa zobrazuje na ľavej strane tabuľky (2). Kliknite na pole pre vkladanie údajov upravo a vpíšte požadovanú hodnotu.
- Ak je dostupný zoznam preddefinovaných vlastností, na konci poľa pre údaje sa zobrazí šípka (3). Kliknutím sa zobrazí rozbalovacie menu, vyberte požadovanú hodnotu.

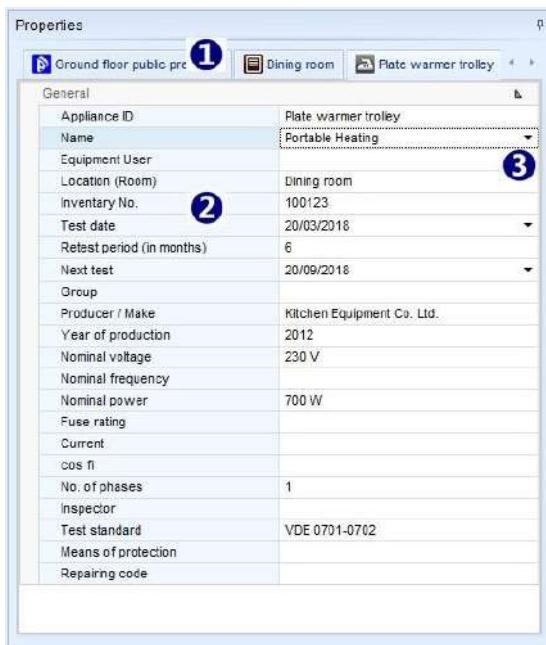

Obr. 6.20: Okno Vlastnosti

7 Vytvorenie údajovej štruktúry

7.1 Základné informácie pred pridaním novej testovacej štruktúry

Metrel ES Manager podporuje vytvorenie stromovej údajovej štruktúry projektu pre testovanie, s objektmi na testovanie umiestnenými v uzloch stromu. Merania môžu byť k objektom priradené pred odoslaním štruktúry do meracieho prístroja.

Pred otvorením nového súboru dátovej štruktúry pre projekt testu si premyslite:

- **Pracovný rámec:** Stanovte si Pracovný rámec svojho projektu.
- **Strom dátovej štruktúry:** Stanovte dátovú štruktúru pre projekt – objekty testu a ich usporiadanie vo vnútri stromovej prezentácie.
- **Zoznam údajov s vlastnosťami:** Zväžte popis vlastností objektov tak, aby výsledky (a report z testu) boli konzistentne prezentované. Všeobecne používané údaje možno uložiť do zoznamu údajov vo vnútri databázovej tabuľky.
- **Testy Autosequence®:** V záujme rýchlejšieho vykonania testu spojte konkrétné testy pre každý objekt a vytvorte skupinu automatizovaných postupností merania Autosequence®. Testovacia postupnosť Autosequence® môže obsahovať zákazníkom vytvorené Kontroly. Pre viac info pozrite do návodu na obsluhu konkrétneho meracieho prístroja.

7.2 Otvorenie novej údajovej štruktúry pre projekt testovania

Postup pri otvorení nového súboru dátovej štruktúry pre projekt testovania:

- (nepovinné) Nastavte cestu dokumentu z Hlavná tabuľka / Nastavenia / Všeobecné
- Vyberte domovskú tabuľku užívateľskej pracovnej plochy.
- Vyberte Pracovný rámec.
- Vyberte Nový súbor.

Nový súbor dátovej štruktúry *.padfx je otvorený, s predvoleným názvom *Nový dokument**. Užívateľská plocha je prázdna, len rodičovský objekt *Uzol* je automaticky umiestnený v stromovom pohľade. To je východiskový bod pre vytvorenie štruktúry projektu. Tento uzol nemožno vymazať, pretože štruktúra musí obsahovať najmenej jeden uzol. Možno ho však premenovať.

Pred pokračovaním sa odporúča:


- Prenovať súbor pomocou príkazu Ulož ako.
- Otvoriť zodpovedajúci súbor Skupina Autosequence® obsahujúci požadované testy, ak je dostupný. Súčasne môže byť otvorený len jeden.

7.2.1 Vytvorenie novej údajovej štruktúry

Tvorba novej štruktúry začína od stromového pohľadu, **Obr. 7.1**:

- Otvorte ponuku Štruktúra (❶). Dostupné objekty sú zvýraznené.
- Vyberte predvolený uzol, kliknite na požadovaný objekt v ponuke Štruktúra. Bude hierarchicky priradený do stromového pohľadu (❷), ako detský objekt – uzol - pod rodičovským uzlom. Pre pridávanie ďalších uzlov postup opakujte.
- Pre rozširovanie stromovej štruktúry , kliknite na niektorý detský uzol, a vyberte k nemu objekt z ponuky. Pre ďalšie rozširovanie postup opakujte.

- Rozširovanie rôznych uzlov na rôznej úrovni možno vykonávať podľa potreby (❸).
 - Popíšte objekty v okne Vlastnosti (❹). Ked' sa vloží názov objektu, ihned' sa podľa toho zaktualizuje aj predvolený názov v stromovom pohľade.
- Každý typ objektu má priradenú sadu vlastností, ktoré možno vložiť manuálne alebo výberom zo zoznamu (predvoleného, alebo vytvoreného užívateľom). Vyplňte všetky nevyhnutné polia s vlastnosťami, aby boli výsledky testu zrozumiteľné a dobre zdefinované.
- Vyššie uvedený postup opakujte, až pokým nie je štruktúra úplná, a súbor uložte.

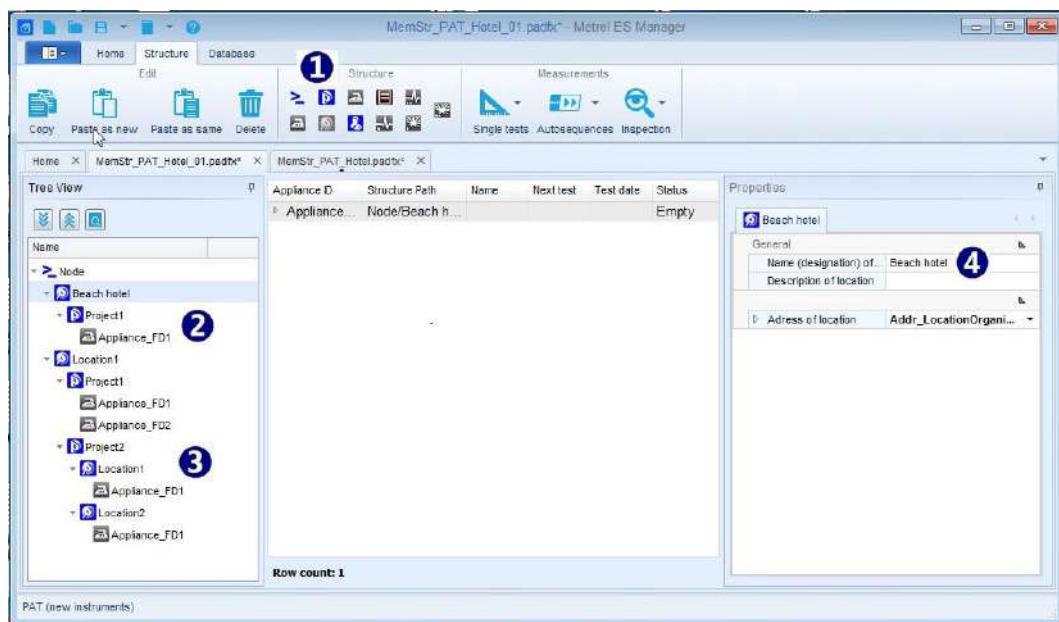

Obr. 7.1: Tvorba novej štruktúry

7.2.2 Priradenie meraní k objektom štruktúry

Presné a spoľahlivé výsledky testov sú zaručené vtedy, ak požadované merania sú parametrizované a priradené k testovacím objektom ešte pred nahraním (uploadom) dátovej štruktúry do meracieho prístroja. Obsluha potom môže spustiť meranie z organizéra pamäte prístroja a výsledky uložiť do toho istého umiestnenia.

Postup:

Vyberte objekt, ku ktorému má byť priradené prázdné meranie. Z ponuky Merania možno vybrať:



- (Jednotlivé testy): Kliknutím na ikonu sa otvorí zoznam dostupných jednotlivých testov, organizovaných v skupinách.
 - Rozbalte požadovanú skupinu a vyberte test, kliknutím na jeho názov.
 - Zobrazí sa nastavovacie okno zvoleného testu, s predvolenými parametrami a limitnými hodnotami.
 - Parametre a limity testu nastavte podľa požiadaviek merania pre zvolený objekt.
 - Pre potvrdenie kliknite na OK v dolnej časti okna, test sa priradí k objektu.
 - Parametre a limity možno prezerať a nastaviť aj neskôr, kliknutím na názov jednotlivého testu vnútri stromového pohľadu sa zobrazí okno s výsledkami; dvojitým klikom na názov merania sa otvorí okno pre nastavenie (❹), Obr. 7.2.
 - Zadajte nové parameter a limity a potvrdte kliknutím na OK.



• **Autosequences: Možnosti:**

Kliknutím na ikonu sa otvorí zoznam testov Autosequence® dostupných z otvorennej Skupiny Autosequence®.

- Otvorte priečinky so súbormi a nájdite požadovaný test Autosequence®.
- Dvojitým kliknutím na Autosequence® sa test automaticky pridá k zvolenému objektu.
- Ak je potrebné, parameter a limity testu Autosequence® možno prezerat' a nastaviť neskôr, **Obr. 7.2**; rozbalte uzel s testom Autosequence® v stromovom pohľade (1), zobrazí sa obsah s jednotlivými testami.
- V stromovom pohľade vyberte jednotlivý test (2), jeho obsah sa zobrazí v okne pre výsledky.
- Dvojitým klikom na jednotlivý test v okne s výsledkami (3) sa otvorí okno s nastaveniami (4).
- Resetujte parameter a limity, a klikom na OK potvrďte nové nastavenie..
- **Poznámka:** Test Autosequence® so zmenenými parametrami a limitmi nie je označený. Pre odlišenie od originálneho je možné pridať komentár k jeho názvu v stromovom pohľade.



Obr. 7.2: Editácia parametrov a limitných hodnôt testu Autosequence®



• **Hiľadanie skupiny súborov Autotest:**

Kliknutím na trojuholník sa ponúkne príkaz na otvorenie prehliadača pre navigáciu k umiestneniu priečinka so súborom skupiny Autosequence obsahujúcim požadovaný Autosequence® test; vyberte súbor a potvrďte výber, otvorí sa. Existujúci súbor je nahradený novým súborom so skupinou Autosequence®; súčasne môže byť otvorený len jeden.



- **(Kontrola):** Kliknutím na ikonu sa otvorí zoznam dostupných kontrol, usporiadaných do skupín.

- Rozbalte skupinu a vyberte kontrolu kliknutím na jej názov.
- Zobrazí sa okno kontroly s predvolenými prázdnymi statusmi.
- V hornej časti tabuľky môžete pridať dátum a čas.
- Potvrďte kliknutím na OK, kontrola sa pridá k zvolenému objektu.

7.3 Vytvorenie štruktúry použitím príkazov Kopírovať a Vložiť

Ak sa časť štruktúry často opakuje, je možné pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť vytvoriť aj veľkú štruktúru rýchlo a jednoducho.

Niekteré nastavenia pracovného rámca umožňujú kopírovanie objektov z jednej údajovej štruktúry do druhej. Štruktúry môžu byť nové, bez meraní, s priradenými prázdnymi meraniami, alebo stiahnuté z prístroja s vykonanými meraniami.

Poznámka o pravidle, ovplyvňujúcim správanie príkazov na kopírovanie:

Každý objekt a meranie vložené do údajovej štruktúry dostane internú unikátnu identifikáciu. V rámci jednej štruktúry môže existovať iba jedna položka s konkrétnym unikátnym identifikátorom.

Príkazy sa zobrazia po pravom kliknutí na objekt v stromovom pohľade, alebo z editačného menu tabuľky so štruktúrou:

- **Kopírovať položku:**
 - Je skopírovaný zvolený objekt a všetky objekty umiestnené v jeho podstrome.
 - Skopírujú sa aj merania priradené k objektu, prázdne alebo vykonané.
 - Skopírované sú aj vlastnosti objektu.
- **Vložiť položku ako novú:**
 - Kopírovaný objekt a všetky podobjekty sú vložené do nového umiestnenia.
 - Prázdne merania priradené k objektom sú tiež vložené a zostávajú nezmenené.
 - Vykonané merania sú vložené ako prázdne merania!
 - Všetky vložené objekty a merania dostanú novú unikátnu identifikáciu!
 - Vlastnosti každého objektu sú tiež vložené a zostávajú bez zmeny!
- **Vložiť položku ako zhodnú:**
 - Všetky objekty a podobjekty sú vložené do nového umiestnenia.
 - Merania pripojené k objektu, prázdne alebo vykonané, zostávajú bez zmeny.
 - Všetky vložené objekty a merania si ponechávajú tú istú unikátnu identifikáciu!
 - Vlastnosti každého vloženého objektu zostávajú nezmenené!

Poznámka:


Ak je príkaz Vložiť neaktívny (šedý), vloženie do zvoleného umiestnenia je dovolené, alebo nebolo nič skopírované.

7.3.1 Kopírovať a Vložiť v rámci rovnakého súboru údajovej štruktúry

Kopírovať&Vložiť ako nové: objekt štruktúry vrátane pod-objektov s **prázdnymi meraniami alebo bez nich**:

Sekvencia príkazov je vhodná na rozšírenie dátovej štruktúry s často sa opakujúcimi spoločnými uzlami, ako napr. hotel s viacerými podlažiami, kde každé obsahuje rovnako vybavené izby (**Obr. 7.3**):

- Vyberte uzol prezentujúci požadovaný objekt (**1**) (prvé poschodie) a vykonajte príkaz Kopírovať
- Vyberte novo umiestnený objekt (**2**) (Hotel) a vykonajte príkaz Vložiť ako nové; opakujte pre každý nový uzol
 - “Vložiť ako nové” bolo opakovane dvakrát (**3**), prezentuje dva nové uzly – hotelové poschodia.
 - Všetky objekty pod vloženým uzlom majú novú unikátnu identifikáciu, ale názvy, vlastnosti a pripojené merania zostávajú tie isté.
- Vyberte každý nový objekt vo vnútri nového uzla a aktualizujte len ich Vlastnosti (**4**), ktoré ich odlišujú od kopírovaného objektu.

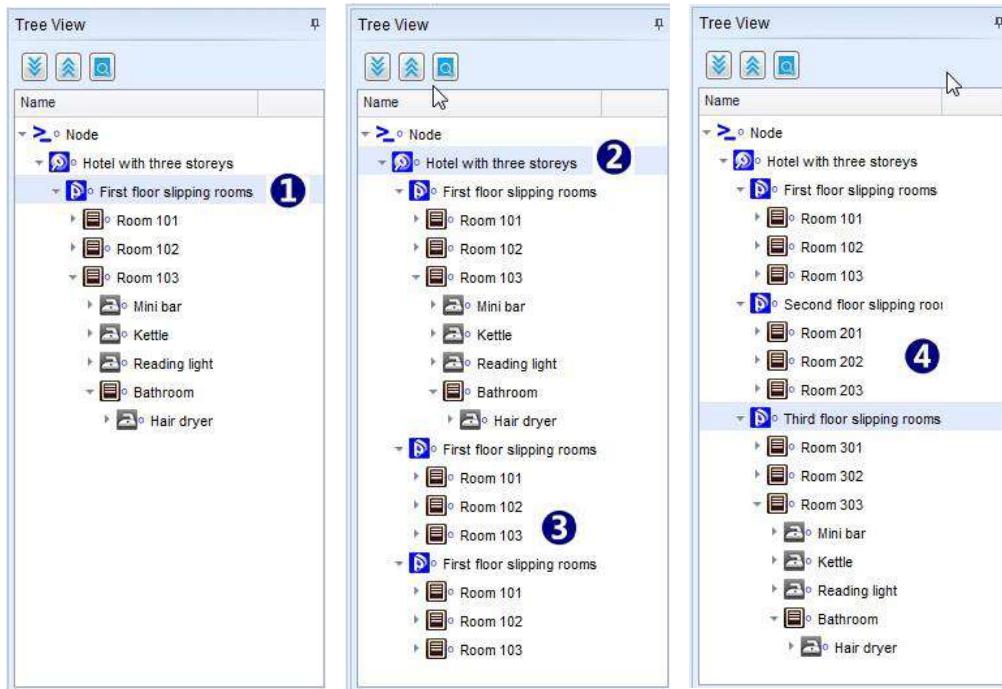


Obr. 7.3: Kopírovať & Vložiť ako nové, v rámci tej istej štruktúry, pripojené s prázdnne meraniami

Kopírovať&Vložiť ako nové: objekt štruktúry vrátane pod-objektov s ukončenými meraniami:

Sekvencia príkazov je vhodná na vytvorenie **novej dátovej štruktúry** s **rovnakými objektmi** a ich **vlastnosťami** a priradenými **rovnakými prázdnymi meraniami** ako má zdrojová štruktúra s ukončenými meraniami, pre opäťovné vykonanie zhodného projektu na rovnakom alebo podobnom umiestnení (**Obr. 7.4**):


- Vyberte najvyšší rodičovský objekt predstavujúci dátovú štruktúru s ukončenými meraniami (**1**) a vykonajte príkaz Kopírovať.
- Vyberte nové umiestnenie (nový uzol bol vložený ako demo) (**2**) a vykonajte príkaz Vložiť ako nové:
 - Vlastnosti vloženého objektu a stromu štruktúry zostávajú rovnaké, všetky objekty majú novú vnútornú unikátnu identifikáciu pre odlišenie od zdrojového objektu.
 - Všetky priložené merania sú prázdnne (**3**), bez výsledkov, nastavenie parametrov a limit zostáva rovnaké ako boli nastavené v ukončenom meraní.
 Všetky merania majú novú unikátnu identifikáciu.

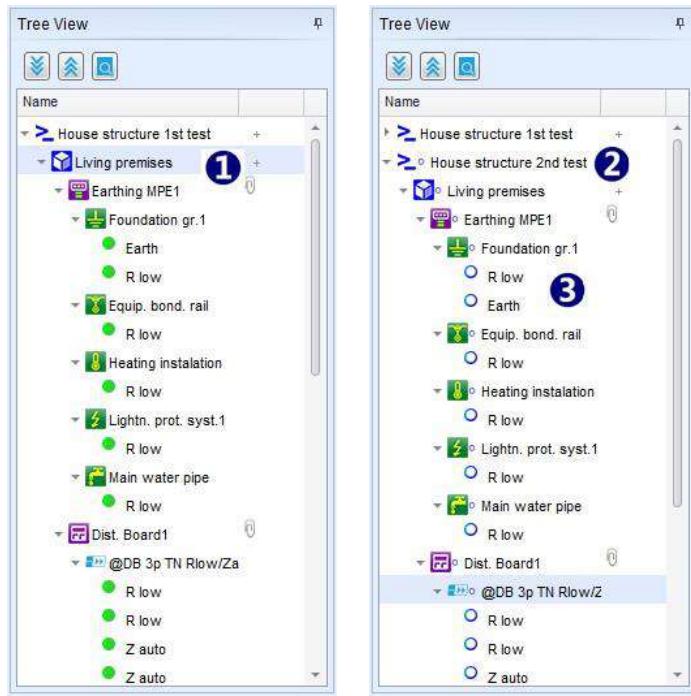

Obr. 7.4: Kopírovať&Vložiť ako nové, v rámci tej istej štruktúry, ukončené merania s výsledkami

Kopírovať&Vložiť ako zhodné:

Pravidlo internej unikátnej identifikácie zabráňuje vykonaniu príkazu *Vložiť ako zhodné* v rámci toho istého súboru dátovej štruktúry. Príkaz *Vložiť ako zhodné* je vykonaný ako *Vložiť ako nové*, pričom sa nakrátko zobrazí upozornenie podľa (Obr. 7.5).

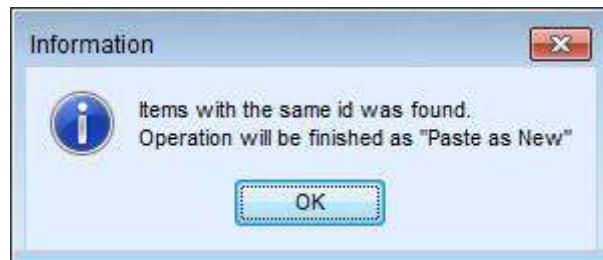

Obr. 7.5: Informačná správa

7.3.2 Kopírovať a Vložiť medzi rôznymi súbormi údajovej štruktúry

Zdrojový a cieľový súbor by mali byť otvorené súčasne, oba musia mať nastavený ten istý Pracovný rámec.

Kopírovať&Vložiť vždy začína rovnako:

- Vyberte tabuľku so zdrojovým súborom, aby bol aktívna v rámci užívateľovej pracovnej plochy
- Vyberte najvyšší rodičovský objekt vo vnútri stromového pohľadu, ktorého podštruktúry by mali byť kopírované, a vykonajte príkaz Kopírovať.

Vložiť ako nový:

- Vyberte cieľovú tabuľku so súborom, aby bol aktívna
- V stromovom pohľade vyberte rodičovský objekt a vykonajte príkaz **Vložiť ako nové**.
 - Vložená štruktúra a vlastnosti objektov zostávajú rovnaké ako zdrojové. Všetky objekty majú novú unikátnu identifikáciu, takže sú odlišené od zdrojových objektov.
 - Všetky pripojené merania, ktoré sú v zdrojovom súbore prázdne alebo s výsledkami, sú vložené ako prázdne, bez výsledkov. Nastavenie parametrov a limít zostáva rovnaké ako v zdrojovom súbore.
 - Všetky merania majú novú internú unikátnu identifikáciu.


Vykonanie príkazov Kopírovať a Vložiť ako nový medzi rozdielnymi súbormi má podobné správanie a výhody ako ich vykonanie v rámci toho istého súboru. Pre viac info časť **7.3.1 Kopírovať a vložiť v rámci rovnakého súboru údajovej štruktúry**.

Vložiť rovnako:

Reakcia príkazu závisí od statusu merania, ktoré je pripojené ku zdrojovej štruktúre, a na internej unikátnej identifikácii objektov a meraní vo vnútri cieľovej štruktúry.


Vložiť rovnako: Objekty zdrojovej štruktúry s pripojenými **prázdnymi meraniami** (alebo bez meraní):

- Vyberte cieľovú tabuľku so súborom, aby sa stala aktívnou
- V stromovom pohľade cieľovej štruktúry vyberte rodičovský objekt a vykonajte príkaz Vložiť rovnako
 - Vyhľadajte internú unikátnu identifikáciu objektu a merania v rámci cieľovej údajovej štruktúry, automaticky sa začne porovnanie so zdrojovou štruktúrou.
- **Rovnaká identifikácia bola nájdená:** Zobrazí sa okno požadujúce potvrdenie pre zlúčenie **Obr. 7.6**:
 - Kliknite na OK, dokončí sa operácia Vloženie so zlúčením údajov. Objekty a Merania si udržia internú unikátnu identifikáciu.
 - Ak chcete príkaz ukončiť bez vloženia, kliknite na Cancel (ukončiť).

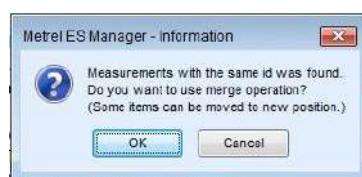

Obr. 7.6: Okno pre potvrdenie zlúčenia

- **Rovnaká identifikácia nebola nájdená:** pokračuje sa oknom podľa **Obr. 7.7**
 - Ak chcete dokončiť príkaz Vložiť, kliknite na Áno (Yes). Objekty a merania si zachovajú internú unikátnu identifikáciu.
 - Ak chcete operáciu prerušiť a skončiť, kliknite Nie (No), údaje nebudú vložené.

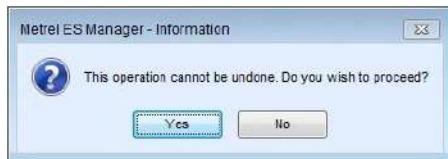

Obr. 7.7: Okno pre potvrdenie

Vložiť rovnako: Zdrojové objekty s pripojenými ukončenými meraniami, cieľová štruktúra má prázdne alebo ukončené merania vykonané s rozdielnymi prístrojmi:

- **Žiadne zhodné unikátne identifikácie Objektov v rámci zdrojových a cieľových údajových štruktúr:**
 - postup je rovnaký ako je opísané vyššie.
- **Zhodné unikátne identifikácie Objektov v rámci zdrojových a cieľových údajových štruktúr:**
 - Postup začne ako je opísané vyššie, až po krok potvrdenia zlúčenia.

Vložiť rovnako: Len zdrojové objekty, cieľová štruktúra

- Užívateľ je vyzvaný vybrať nasledujúci príkaz pre vloženie, **Obr. 7.8:**
 - **Merge duplicates using source data** (zlúčiť duplikáty použitím zdrojových údajov): Objekty cieľovej štruktúry s rovnakou identifikáciou sú aktualizované zdrojovými údajmi, zvyšok je vložený rovnako ako zdrojové údaje.
 - **Relocate structure** (premiestniť štruktúru): zdrojové údaje budú vložené do cieľovej štruktúry ako prídavný uzol podstromu. Nové objekty majú novú internú unikátnu identifikáciu.
- Ďalej sa postupuje podľa pokynov na obrazovke, už bolo opísané vyššie.



Obr. 7.8: Okno pre potvrdenie vloženia

Merge (zlúčenie): Príklad použitia:

Hotel s viacerými izbami a poschodiami – je požadovaná správa za celý hotel.

Kompletná štruktúra a merania sú odoslané do viacerých prístrojov – každý prístroj robí merania len na jednom poschodi. Po ukončení meraní sú údaje so všetkých prístrojov stiahnuté do programu Metrel ES Manager.

Použitím funkcie Merge (zlúčiť) sú všetky údaje (stiahnuté z rôznych prístrojov) zlúčené do jedného súboru obsahujúceho kompletnú štruktúru a kompletné merania. Následne je možné vyhotoviť kompletnú Správu z merania.

Relocate (premiestnenie) : Príklad použitia:

Hotel s viacerými izbami a poschodiami – je požadovaná správa za celý hotel.

Rovnaká štruktúra, pokrývajúca len jedno hotelové poschodie, je odoslaná do viacerých prístrojov. Každý prístroj urobí merania len na jednom poschodi. Po ukončení meraní sú údaje so všetkých prístrojov stiahnuté do programu Metrel ES Manager.

Použitím funkcie Relocate sú údaje z jednotlivých poschodí skombinované do jedného súboru. Následne je možné vytvoriť kompletnejšiu Správu z merania.

Poznámka ku funkciu zlúčenia:

Zdrojové objekty s pripojenými prázdnymi meraniami, cieľové objekty s pripojenými ukončenými meraniami:

- Zlúčená štruktúra a objekty zostávajú rovnaké, prázdne merania sú pripojené k adekvátnym objektom ako prídavok k nezmeneným ukončeným meraniam.

7.3.3 Kopírovať a Vložiť medzi rozdielnymi pracovnými rámcmi

Údajové štruktúry vytvorené v odlišných Pracovných rámcach môžu byť otvorené súčasne. Všeobecne povedané, obsah štruktúry nemôže byť kopírovaný do štruktúry vytvorenej v inom pracovnom rámci. Existujú však výnimky pre niektoré objekty štruktúry, ktoré sú spoločné v rámci rôznych pracovných rámcov.

Napríklad, objekty ako Spotrebiče, Spotrebiče FD, Stroje s pod-objektami, EVSE (nabíjačky elektrovozidiel) s pod-objektami sú spoločné pre rozdielne pracovné rámce a môžu byť kopírované a vkladané medzi štruktúrami vytvorenými v rozdielnych pracovných rámcach.

Vždy keď môžu byť objekty štruktúry prenesené medzi štruktúrami rozdielnych pracovných rámcov, automaticky to znamená, že medzi tými štruktúrami môžu byť prenesené aj všetky merania.

Zdieľanie údajov medzi štruktúrami rôznych pracovných rámcov podlieha zmenám, keďže pracovné rámce sú priebežne zlepšované.

7.4 Vytvorenie údajovej štruktúry pre opakovany test spotrebiča

Ak je pre testovaný spotrebič nastavená doba opakovaneho testu, a súbor údajovej štruktúry s ukončenými meraniami už existuje, pre vytvorenie projektového súboru údajovej štruktúry na opakovany test možno využiť nástroj nadchádzajúce opakovane testy (Upcomming retests).

- Nastavte cestu dokumentu (pozrite kapitolu 6.2.1.1 Menu Nastavenia), kde sú uložené súbory údajovej štruktúry.
- V hlavnom menu Nastavenie nastavte pracovný rámec testovanie PAT. V hlavnej ponuke Nástroje sa zobrazí ikona editoru Nadchádzajúcich opakovanych testov.




- **Upcomming retests**: Po kliknutí na ikunu sa otvorí okno editora pre nastavenie budúci opakovanych testov pre test spotrebičov.
 - Editor plánovaných opakovanych testov automaticky vyhľadá spotrebiče v rámci **všetkých súborov dátovej štruktúry** uložených v nastavenom umiestnení.

- **Možnosti editora (Obr. 7.9):**

- **Dátumový filter:** Po zadani dátumovej periódy sa automaticky vyhľadajú vyhovujúce spotrebiče.
- **Opäťovné načítanie (Reload):** Zoznam spotrebičov sa nanovo načíta.
- **Vytvorenie súboru .padfx:** Vytvorenie súboru údajovej štruktúry obsahujúceho vybrané spotrebiče s ukončenými alebo novými prázdnymi testami, ktoré treba vykonať, umiestnenými vnútri rovnakých prvkov štruktúry ako v stiahnutom súbore, ktorý je uložený v prehľadávanom priečinku. Pre výber viacerých spotrebičov použite shift+klik, ctrl+klik, klikni&potiahni v rámci stĺpca vľavo. Je vytvorený iba jeden súbor údajovej štruktúry,

s viacnásobnými uzlami, kedy zvolené spotrebiče patria k viac než jednému súboru údajovej štruktúry.

- **Otvorí zvolený súbor:** Otvorí súbor priradený k zvolenému spotrebiču. Otvorené môžu byť viaceré súbory, ak zvolené spotrebiča patria viac než k jednému súboru.
- **Zavrieť:** Zavrie editor.
- **Náhľad tlače:** Otvorí sa náhľadové okno so zoznamom plánovaných testov, v ktorom možno robiť úpravy pred tlačou alebo exportom do pdf alebo obrázku.
- **Tlač:** Priama tlač zoznamu testov.
- **do PDF:** Vytvorenie zoznamu vo formáte pdf; užívateľ bude vyzvaný na zadanie názvu súboru a jeho umiestnenia.

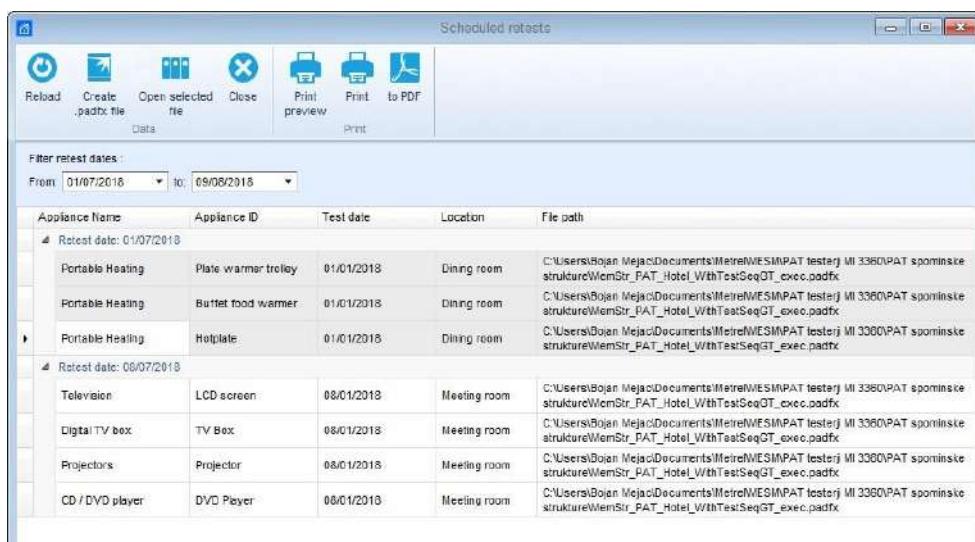

The screenshot shows a software interface titled 'Scheduled tests'. At the top, there are several icons: Reload, Create .padfx file, Open selected file, Close, Print preview, Print, and to PDF. Below the toolbar, there is a date filter section with 'From' set to '01/07/2018' and 'to' set to '09/08/2018'. The main area is a table with columns: Appliance Name, Appliance ID, Test date, Location, and File path. The table contains two groups of rows, each corresponding to a different retest date: '01/07/2018' and '08/07/2018'. Each group lists four different appliances: Portable Heating, Buffet food warmer, Hotplate, Television, Digital TV box, Projectors, and CD / DVD player. Each row provides the appliance name, ID, test date (either 01/01/2018 or 08/01/2018), location (Dining room or Meeting room), and the full file path where the test results are stored.

Appliance Name	Appliance ID	Test date	Location	File path
Re-test date: 01/07/2018				
Portable Heating	Plate warmer trolley	01/01/2018	Dining room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
Portable Heating	Buffet food warmer	01/01/2018	Dining room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
Portable Heating	Hotplate	01/01/2018	Dining room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
Re-test date: 08/07/2018				
Television	LCD screen	08/01/2018	Meeting room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
Digital TV box	TV Box	08/01/2018	Meeting room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
Projectors	Projector	08/01/2018	Meeting room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx
CD / DVD player	DVD Player	08/01/2018	Meeting room	C:\Users\Bojan Mejac\Documents\MetrelWESIMPAT testerj MI 3360PAT spominiske strukture\WemStr_PAT_Hotel_WithTestSeqGT_exec.padfx

Obr. 7.9: menu editora plánovaných opakovaných testov

- Zo zoznamu plánovaných opakovaných testov spotrebičov vyberte spotrebiče, ktoré sa majú testovať, vykonajte **Create .padfx file**:
 - Súbor s testami je otvorený v novej záložke (1) s predvoleným názvom Nový dokument.
 - Spotrebiče sú zobrazené v rovnakej štruktúre stromového pohľadu (2), s rovnakými vlastnosťami objektu (3) ako to bolo v zdrojovej štruktúre, s výnimkou toho, že predchádzajúce ukončené merania sú pridané ako prázdné (4).
 - V okne s výsledkami možno prezeráť predchádzajúce ukončené merania, a prázdné merania a limity možno editovať (4).
- Pre pomenovanie nového súboru použite príkaz Uložiť' ako.
- Okno so zoznamom plánovaných testov sa automaticky zaktualizuje, ak sa merania reálne vykonajú a stiahnu z prístroja späť do Metrel ES Manager.

The screenshot shows the 'New Document 1' window in the Multi ESD Manager application. The interface includes a top menu bar with Home, Structure, Database, Communication, Reports, Tools, Setting, and Work scope. Below the menu is a toolbar with icons for Home, New, Open, Save, Get Data, Send Data, Connect, Get instrument info, Create, Manage, Auto Sequence Editor, Print Results, Template Editor, Upcoming tests, Basic report, and Work scope.

Tree View: On the left, a tree view shows the structure path: Node/Beach Hotel/Gr... > Buffet food warmer > Beach Hotel > Ground floor public > Dining room > Plate warmer tro... > CL_1_b_AICP. A callout **1** points to the tree view area.

Table View: The main area displays two tables of test results. The first table, for **CL_1_a_AICP**, has rows for Visual, Continuity, Differential Leakage, Touch Leakage, and Functional tests. The second table, for **CL_1_b_AICP**, also has rows for these categories. Callouts **2** point to the table rows, and **4** points to the functional test rows.

Properties: On the right, the 'Properties' panel is open for the selected item, showing a 'General' tab with fields like Appliance ID, Name, Equipment User, Location (Room), Test date, Re-test period, Next test, Group, Producer / Make, Year of product, Nominal voltage, Nominal frequency, Nominal power, Fuse rating, Current, cos φ, No. of phases, Inspector, Test standard, Means of protec..., and Repairing code. Callout **3** points to the properties panel.

Obr. 7.10: Nový súbor štruktúry opakovanych testov

8 Komunikácia s prístrojom

8.1 Nadviazanie komunikácie s prístrojom

Komunikácia s prístrojom môže prebiehať cez RS232 port alebo USB port.

- Kliknutím na  ,  alebo  sa otvorí okno pre nastavenie parametrov komunikácie.
- Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte COM port, ku ktorému je prístroj pripojený.
- Rýchlosť prenosu (Baud rate) je predvolene nastavená na Auto. Ak to chcete zmeniť, kliknite na záložku Avanced.



Obr. 8.1: Nastavenie komunikácie

8.1.1 Informácie o prístroji

Je možné získať základné informácie o prístroji (Názov, výrobca, typ, výrobné číslo, HW a FW verzie, dátum kalibrácie atď.) ako aj info o dostupnej aktualizácii FW. Ak sa údaje nezobrazia, pozrite kapitolu [Riešenie problémov](#).

Možnosti:

- Kontrola dostupnosti aktualizácií FW
 - Stiahnite novú aktualizáciu FW
- Pozrite so nové poznámky k prístroju



Obr. 8.2: Info o prístroji s možnosťami

8.1.2 Aktualizácia Firmware

Nové typy prístrojov ponúkajú možnosť aktualizácie (upgrade) FW na najnovšiu verziu. Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Kliknite na Stiahnut' (Download) a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Spustí sa program FlashMe.



Poznámka

Pre viac info o nastavení prístroja pozrite návod na obsluhu ku vášmu prístroju.

8.2 Upload a download projektových súborov

Upload alebo download súborov s projektmi údajovej štruktúry možno vybrať z hlavného okna v skupine Komunikácia. Je podporovaný prenos jedného, alebo aj viacerých súborov.

8.2.1 Možnosti prenosu jedného súboru



- **GetData** (Získať údaje): Stiahne údaje z prístroja. Aktuálne aktívny súbor údajovej štruktúry v Organizéri pamäte v prístroji sa stiahne do PC.

- Ak je užívateľ len v hlavnom okne programu, stiahnutý súbor sa otvorí v novej záložke.
- Ak súbor údajovej štruktúry je už otvorený, otvorí sa okno s možnosťami sťahovania, Obr. 8.3:

Stiahnut' do nového súboru: Otvorí sa nová záložka




Stiahnut' do aktuálne otvoreného súboru: Objekty s rovnakou unikátnou identifikáciou sú zlúčené, ostatné sa ukážu ako nové, v rámci aktívneho súboru.




Obr. 8.3: Okno s možnosťami stiahovania

-  **Send Data** Poslat údaje (Upload): Aktívny súbor údajovej štruktúry je odoslaný do prístroja (po kontrole licenčného kľúča a profilu prístroja).

8.2.2 Možnosti prenosu viacerých súborov

-  **Connect**: Spojit': Otvorí sa okno (**Obr. 8.4**) pre spravovanie prenosu skupiny súborov medzi pripojeným prístrojom a PC.
- **Možnosti:**
 -  **Project list**: Zoznamy súborov uložených v prístroji
 -  **Upload projects**: Zoznamy projektov uložených v zvolenom priečinku v PC
 -  **Licenses**: Zoznamy licenčných kľúčov uložených v prístroji
 -  **Instrument info**: informácie o pripojenom prístroji
- **Príkazy:**
 -  **Reload**: Opäťovné načítané údaje
 -  **Download selected**: Stiahnutie vybraných súborov s projektmi z prístroja
 -  **Delete selected**: Vymazanie vybraných súborov s projektmi z prístroja
 -  **Upload selected**: Odoslanie vybraných súborov s projektmi do prístroja
 -  **Port**: Vyberte so zoznamu port PC, ku ktorému je pripojený prístroj

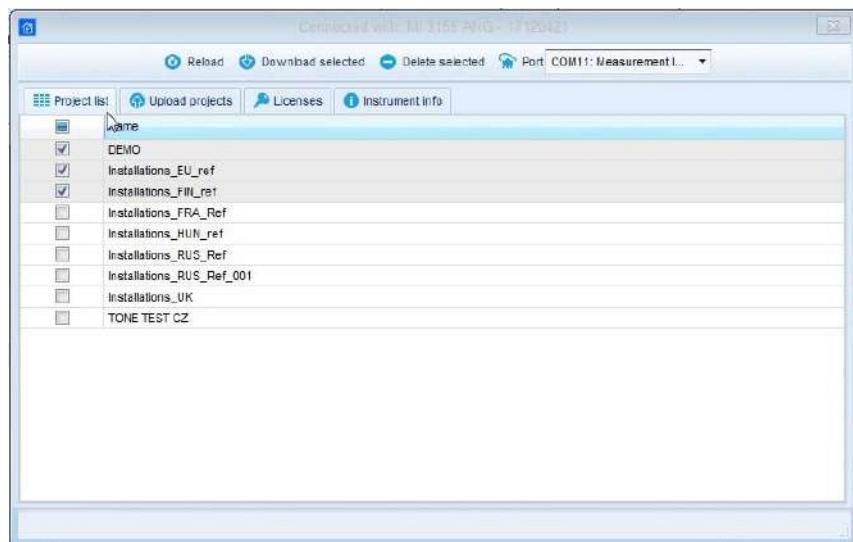

Obr. 8.4: Okno s menu pre pripojenie

9 Tlač výsledkov

9.1 Možnosti tlače výsledkov

Metrel ES Manager ponúka dva jednoduché tlačové formáty, ktoré sú dostupné zo skupiny Nástroje z domového menu:

- Tlačiť výsledky
- Základný report, s možnosťou Filtrovaný základný report


Pred tým, ako začnete vytvárať dokument pre tlač, zväžte prípravu:

- Zoznam adres – často používané adresy zákazníkov pre tlač do hlavičky reportu
- Zoznam zodpovedných osôb – často používané údaje obsluhy pre tlač do hlavičky reportu

9.1.1 Formát tlače výsledkov


Najprv vytvorte hlavičku dokumentu:

- V ponuke Nastavenia (v Hlavnom menu) vyberte Hlavička na tlač
- Vyberte Printout results (**Obr. 9.1**), zobrazia sa možnosti:
 - **Zmeniť obrázok loga:** Otvorí sa prehliadač pre nájdenie priečinky s obrázkom; vyberte ho a otvorte.
 - **Vymazať obrázok loga:** Vymaže existujúce logo.
 - **Pole 1:** Manuálne vpíšte údaje zákazníka, alebo vyberte zo zoznamu; ponúkne sa zoznam adres z databázy.
 - **Pole 2:** Manuálne vpíšte meno zodpovednej osoby, alebo vyberte meno zo zoznamu; ponúkne sa zoznam zodpovedných osôb z databázy.

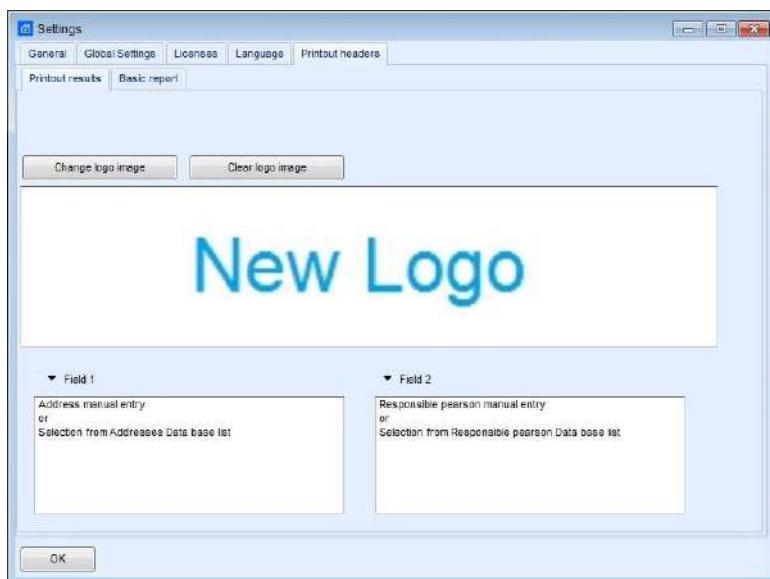

Obr. 9.1: Nastavenie hlavičky pre tlač

- Otvorte súbor s projektom a v stromovom pohľade vyberte najvyšší rodičovský objekt, pre podstrom ktorého sa má vygenerovať správa. Pre tlač všetkých výsledkov vyberte uzol, pre tlač len jedného testu vyberte konkrétné meranie.
- V záložke Domov / Nástroje kliknite na Print Results (Tlačit' výsledky), otvorí sa náhľadové okno s dokumentom, **Obr. 9.2**.

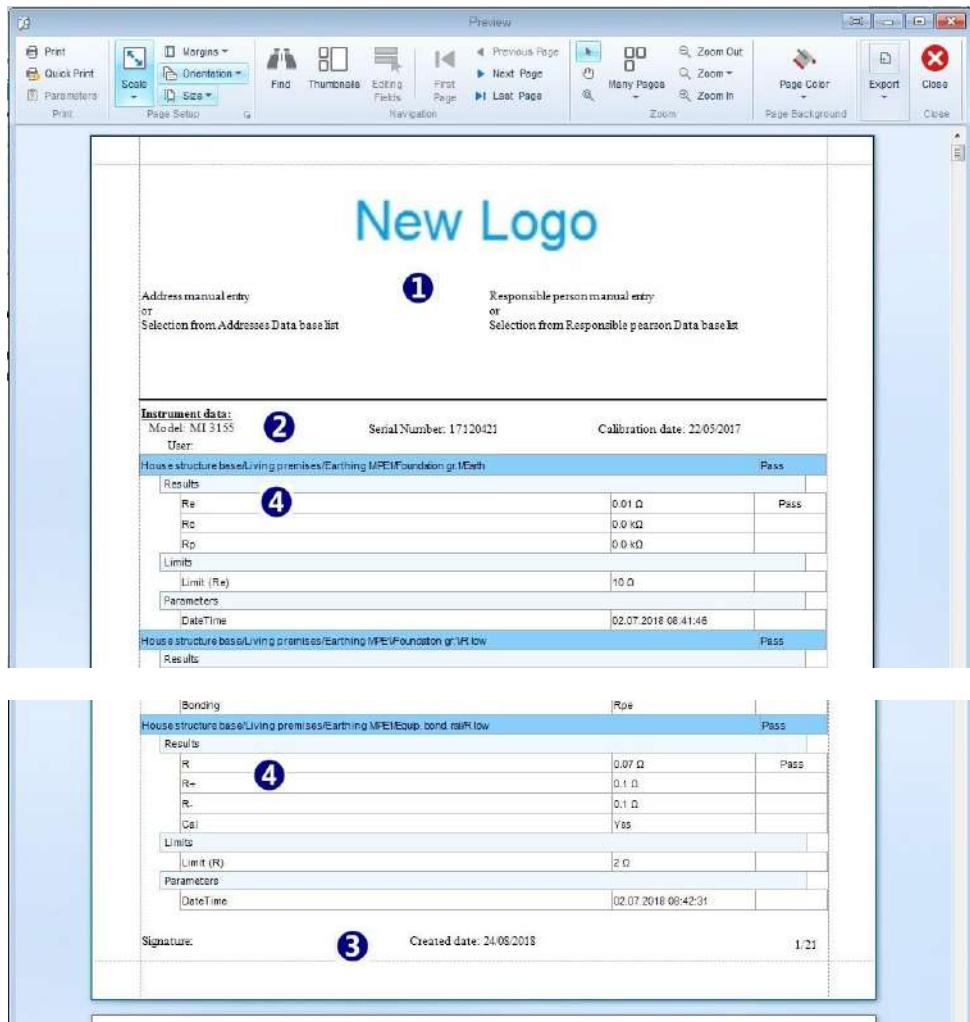

Obr. 9.2: Náhľad dokumentu pre tlač

- **Hlavica** so zobrazuje v hornej časti prvej strany:
 - Miesto testu, údaje operátora a logo (1) sa nastavujú v menu Nastavenia / Tlač výsledkov.
- **Údaje prístroja** (2) sa nastavia automaticky po stiahnutí súboru.
- **Päta** dokumentu (3) sa zobrazuje v dolnej časti každej strany, a obsahuje:
 - Podpis – dopĺňa sa ručne
 - Dátum vytvorenia je nastavený automaticky
 - Číslovanie strán je zadané automaticky.
- **Výsledky merania** s parametrami a limitami sú prezentované v tabuľke (4), doplnené o individuálny status.
- **Nastavte** rozloženie strany pre tlač a vytlačte ju.

POZNÁMKA:

K dispozícii sú aj možnosti pre export dokumentu:

- Export do PDF.
- Export do obrazového súboru (formát sa vyberá z menu).
- E-Mail ako PDF
- E-Mail ako obrázok.

9.1.2 Základný report

Dostupné možnosti:

-  **Basic report** kliknite priamo na ikonu **Základný report**
-  **Basic report** kliknite na šípku, ponúkne sa možnosť **Filtrovaný základný report**

Reporty možno tlačiť pre kompletnejšiu štruktúru, alebo len pre vybrané objekty.

9.1.2.1 Vytvorenie základného reportu

Najprv vyberte logá, ktoré sa majú vytlačiť v hlavičke základného reportu:

- V hlavnom menu vyberte Nastavenia / Hlavička na tlač / Základný report
- Možnosti okna (**Obr. 9.3**) :
 - **Prehľadávať**: Otvorí sa prehliadač pre výber obrázku.
 - **Vyčistiť**: Vymaže existujúce logo.
 - **Logo 1**: Logo sa zobrazí v hornej pravej časti hlavičky.
 - **Logo 2**: Logo sa zobrazí v dolnej pravej časti hlavičky.
 - **Počet zobrazených znakov**: Zadajte počet znakov pre názov merania, ktorý sa vytlačí v reporte. Nastavenie na -1 umožňuje vytlačenie všetkých znakov.
- Otvorte súbor s projektom a v stromovom pohľade vyberte najvyšší rodičovský objekt, pre podstrom ktorého sa má vytvoriť správa. Pre tlač všetkých výsledkov vyberte uzol, pre tlač len jedného testu vyberte konkrétné meranie.




Obr. 9.3: Nastavenie loga pre hlavičku základného reportu

- Kliknite na Basic report (Základný report) v záložke Domov / Nástroje, zobrazí sa okno s náhľadom dokumentu pre tlač, Obr. 9.4.



- Editing fields** (Editovanie polí): Hlavička a päta dokumentu obsahujú editovateľné polia. Kliknutím na ikonu (Editing Fields) v hornej časti náhľadového okna sa zvýraznia.
- Hlavička dokumentu** (1) za zobrazuje v hornej časti každej strany:
 - Logo 1 a Logo 2, sú nastavené v menu Nastavenia.
 - Editovateľné (modro zvýraznené) polia možno vyplniť manuálne.
- Údaje prístroja** (2) sa zobrazujú na začiatku zoznamu výsledkov len na prvej strane, sú nastavené automaticky podľa stiahnutého súboru.
- Päta dokumentu** (3) sa zobrazuje v spodnej časti každej strany, a obsahuje:
 - Podpis - ručne
 - Číslovanie strán – je zadané automaticky.
 - Editovateľné (modro zvýraznené) polia možno vyplniť manuálne, vrátane dátumu.
- Výsledky** (4) sú prezentované v dvoch riadkoch tabuľky:
 - Prvý riadok začína ikonou objektu, nasleduje cesta objektu v rámci štruktúry, a výrobné číslo prístroja.
 - Druhý riadok začína popisom merania, nasleduje dátum testu, celkový status, potom výsledky, parametre, limity pre každý individuálny test.
- Upravte** rozloženie dokumentu a vytlačte ho.

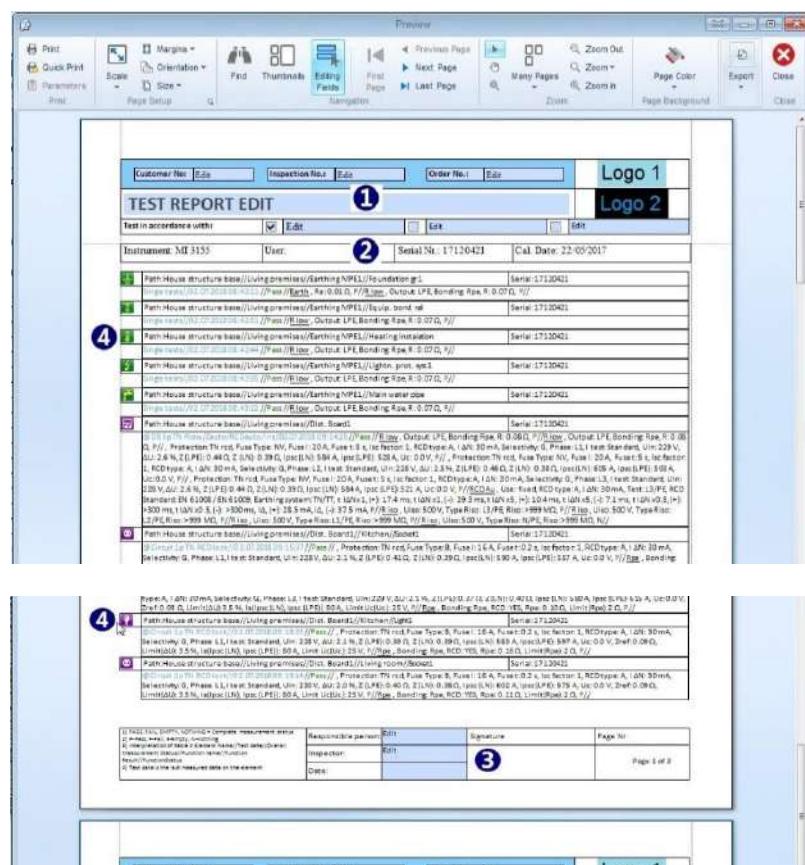

Obr. 9.4: Náhľad dokumentu Základný report

POZNÁMKA:


K dispozícii sú aj možnosti pre export dokumentu:

- Export do PDF.
- Export do obrazového súboru (formát sa vyberá z menu).
- E-Mail ako PDF
- E-Mail ako obrázok.

9.1.2.2 Vytvorenie filtrovaného základného reportu

Postup vytvorenia filtrovaného základného reportu je rovnaký ako pri vytváraní základného reportu, navyše ale pribudli možnosti filtrovania (**Obr. 9.5**). Okno pre nastavenie filtra sa zobrazí, ak je zvolená možnosť Filtrovaný základný report:

- **Dátum od / do:** nastaví rozsah dátumov (❶) pre výber meraní do reportu.
- **Zahrnúť podvýsledky:** ak chcete zahrnúť aj podvýsledky (štandardne zahrnuté nie sú), označte zaškrťávacie poličko (❷).
- **Zahrnúť limity:** ak chcete zahrnúť aj limity (štandardne zahrnuté nie sú), označte zaškrťávacie poličko (❸). Pri označení limít sa automaticky označia aj podvýsledky.
- Potvrďte nastavenie, otvorí sa náhľadové okno s dokumentom.

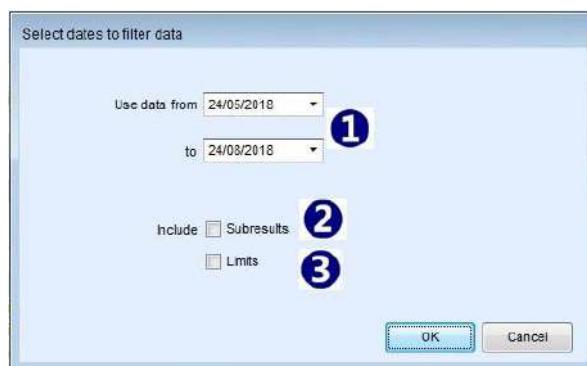

Obr. 9.5: Okno pre nastavenie filtra

10 Správy z merania

10.1 Vytvorenie správ

Metrel ES Manager podporuje tvorbu komplexných správ z merania, ktoré obsahujú stránky s kontrolami a stránky s výsledkami testov. Správy sú údajovo štruktúrované formuláre, vychádzajúce z preddefinovaných šablón podľa národných pravidiel. Vytvorené správy sú uložené v súbore štruktúry, v podpriečinku /reports. Možnosti tlače a tvorby súboru pdf záleží na licenčných právach, s ktorými boli merania vykonané. Ak formulár správy nemá príslušnú licenciu, zobrazí sa v demo režime, s príslušným oznamom v pravej dolnej časti okna s náhľadom.

10.1.1 Vytvorenie novej správy krok za krokom


Novú správu možno vytvoriť na základe súboru stiahnutého z prístroja, s využitím pomocníka v menu Správy. Pomocník je nástroj, ktorý vás sprevádza tvorbou správy krok za krokom až po vytvorenie finálneho dokumentu spôsobom “čo vidíte, to dostanete”. Niektoré polia v dokumente sú predvyplňené automaticky, iné možno vypĺňať manuálne. Pri niektorých políčkach sa ponúkne rozbaľovacie menu s možnosťami.

POZNÁMKA:

Predvolené je automatické číslovanie stránok. Ak chcete stránky číslovať manuálne, odškrtnite políčko “Vytvoriť čísla strán reportu” v menu Nastavenia / Všeobecné [Create report's numbers of Pages]. Nové nastavenie sa uloží.

10.1.1.1 Výber formátu správy

Užívateľ si môže vybrať z predpripravených šablón:


- Otvorite súbor a v rámci stromového pohľadu vyberte objekt, z merania ktorého sa má vytvoriť správa.
- V záložke Domov / Správy kliknite na ikonu  (Vytvoriť), otvorí sa okno podľa **Obr. 10.1**.
-  : Štandardne nie je filter aktívny, do správy sú zahrnuté všetky merania. Ak chcete vybrať merania podľa dátumu, označte políčko “Zahrnúť merania”, otvorí sa možnosť pre zadanie dátumov od/do.
- Zo zoznamu vyberte šablónu a kliknite na tlačidlo  (Správa) vľavo dele. Zvolený formulár sa otvorí v editovacom okne. Ďalšie možnosti tlačidla “Správy” sú “Vytvoriť pdf” a “Tlačiť správu”, obe bez ďalších možností editácie.

POZNÁMKA:

Dostupné formuláre (šablóny) sú zobrazené s modrým pozadím, a závisia od vlastností zvoleného objektu. V príslušnom riadku sa tiež zobrazuje počet licencovaných a všetkých správ:

Licensed:0 znamená, že licenčné práva nie sú dostatočné správa bude dostupná len v režime demo.

Ak číslo All: je >1 znamená že pod-strom zvoleného objektu obsahuje viac než jeden objekt, pričom správa je vytvorená pre každý zvlášť. Je to rovnaké, ako keď je vybraný viac než jeden objekt.

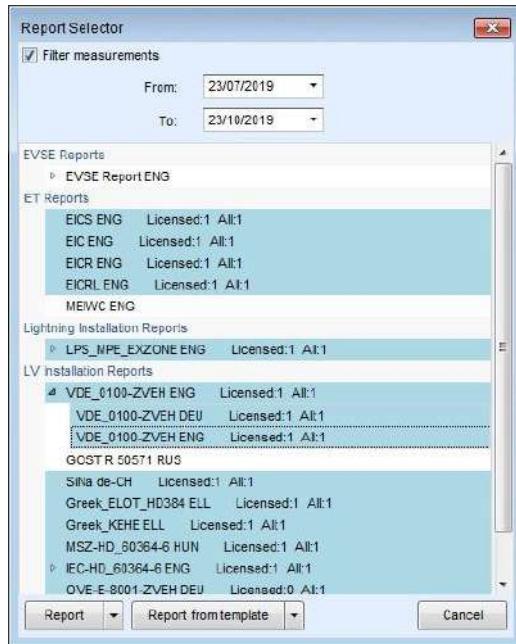

Obr. 10.1: Okno pre výber správy

10.1.1.2 Okno pre editáciu správy

Zvolený formulár správy sa otvorí v okne pre editáciu, **Obr. 10.2**:

Možnosti úprav sú dostupné z ponuky v hornej časti okna:

- Príkazy sú organizované v skupinách v hornej lište (❶).
- Každá stránka dokumentu je zobrazená na samostatnej záložke (❷).
- Náhľad vzhľadu dokumentu (❸).
- Tlačidlá zoznamu databáz (❹): kliknutím sa zobrazia možnosti pre vloženie údajov do príahlého poľa.
- Výber strán (❺): umožňuje vybrať, ktoré strany sa budú tlačiť alebo ukladať do pdf.

Obr. 10.2: Okno pre editáciu správy

10.1.1.3 Kontrola a vyplnenie jednotlivých stránok správy

Zobrazenie jednotlivých stránok zodpovedá vzhľadu po tlači.

Užívateľ môže kliknúť na každé pole na stránke a modifikovať ho.

Nasledujúci obrázok zobrazuje ako vybrať dátum z kalendára (1), a vybrať adresu z databázy (2).

EIC

Report	Navigator	Print						
Save	Close	First	Previous	Next	Last	to PDF	Print	
Page 1	Page 2	Page 3	Page 4	Page 5	Page 6	Page 7	Page 8	Page 9

(REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS - BS 7671 (IET WIRING REGULATIONS))

DETAILS OF THE CLIENT

client_text_name, client_text_org
Post Code: 1324_CI

Organizational Name Address Telephone Mobile Fax Email Register no... Postcode
client_text_name, client_text_address

Post Code: 1354-client
Installation

client_text_name, client_text_address
Post Code: 1354-client
Installation

2 Connection to an existing installation

Alteration to an existing installation

(Use continuation sheet if necessary)

FOR DESIGN
We being the person(s) responsible for the design of which are described above, having exercised due care and skill in the preparation of the design work for which they have been responsible and amended to: (Leave empty for the design as issued)
Details of departures from BS 7671 (Regulation No.)

29 October 2014
October 2014
Date of issue

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

No. _____
Hand my /our signatures below, particulars out the design hereby CERTIFY that the same is in accordance with BS 7671:2008.

1 Name (IN BLOCK LETTER): _____
Signature: _____ Date: _____
Designer No 1

above as the subject of this Certificate:
Responsibility for the design:

Obr. 10.3: Príklad výberu dátumu a adresy

Namerané údaje:

Namerané údaje (❸), ktoré boli stiahnuté z meracieho prístroja, ako aj označené políčka (❹), sú automaticky vložené do tabuľky.

Report		Navigation		Print																												
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Close"/>	<input type="button" value="First"/>	<input type="button" value="Previous"/>	<input type="button" value="Next"/>	<input type="button" value="Last"/>																											
				<input type="button" value="To PDF"/>	<input type="button" value="Print"/>																											
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9																																
DB reference no Location _____ Zs at DB (Ω) _____ I _g at DB (mA) _____ Correct supply polarity confirmed <input checked="" type="checkbox"/> Phase sequence confirmed (where appropriate) <input type="checkbox"/>			Details of circuits and/or installed equipment vulnerable to damage when testing Continuity Insulation resistance Earth fault loop impedance RCD Earth electrode resistance																													
Tested by: Name (Capital letters) Signature _____ Date _____			Test results																													
Circuit details <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuit number</th> <th rowspan="2">Circuit Description</th> <th colspan="2">Overcurrent device</th> <th colspan="2">Conductor details</th> </tr> <tr> <th>BS (EN)</th> <th>Type</th> <th>Rating (A)</th> <th>Breaking Capacity (kA)</th> <th>Reference Method</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Circuit number	Circuit Description	Overcurrent device		Conductor details		BS (EN)	Type	Rating (A)	Breaking Capacity (kA)	Reference Method													Ring final circuit continuity (Ω) $Z_1 = Z_2$ (Imp)	Continuity (C1 or R ₂) $R_1 + R_2 = 0$ (Imp)	Insulation Resistance (MΩ) $R_1 = R_2$ (Imp)	Polarity	Z _s (Ω) $I_g = I_{g1}$ (mA)	RCD (ms)	Remarks (continue on a separate sheet if necessary)
Circuit number	Circuit Description	Overcurrent device			Conductor details																											
		BS (EN)	Type	Rating (A)	Breaking Capacity (kA)	Reference Method																										
1	Circuit1 socket A1 socket A2	BS 88-2	10	I _g	2.5	2.5	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	0	0.46	36	39															
2	Fixed connection A3	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	1.5	<input checked="" type="checkbox"/>	0.46	36	39															
3	Circuit2	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
4	Circuit3	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
5	Circuit4	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
6	Circuit5	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
7	Circuit6	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
8	Circuit7	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
9	Circuit8	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
10	Circuit9	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
11	Circuit10	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
12	Circuit11	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
13	Circuit12	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
14	Circuit13	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
15	Circuit14	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
16	Circuit15	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
17	Circuit16	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
18	Circuit17	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
19	Circuit18	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
20	Circuit19	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
21	Circuit20	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
22	Circuit21	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
23	Circuit22	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
24	Circuit23	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
25	Circuit24	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
26	Circuit25	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
27	Circuit26	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
28	Circuit27	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
29	Circuit28	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
30	Circuit29	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
31	Circuit30	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
32	Circuit31	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
33	Circuit32	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
34	Circuit33	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
35	Circuit34	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
36	Circuit35	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
37	Circuit36	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
38	Circuit37	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
39	Circuit38	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
40	Circuit39	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
41	Circuit40	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
42	Circuit41	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
43	Circuit42	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
44	Circuit43	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
45	Circuit44	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
46	Circuit45	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
47	Circuit46	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
48	Circuit47	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
49	Circuit48	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
50	Circuit49	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
51	Circuit50	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
52	Circuit51	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
53	Circuit52	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
54	Circuit53	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
55	Circuit54	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
56	Circuit55	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
57	Circuit56	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
58	Circuit57	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
59	Circuit58	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
60	Circuit59	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
61	Circuit60	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
62	Circuit61	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
63	Circuit62	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
64	Circuit63	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
65	Circuit64	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
66	Circuit65	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
67	Circuit66	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
68	Circuit67	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
69	Circuit68	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
70	Circuit69	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
71	Circuit70	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
72	Circuit71	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
73	Circuit72	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
74	Circuit73	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
75	Circuit74	BS 88-2	10	C	2.5	4	1.59	1.57	1.49	0.45	0.15	761	625	<input type="checkbox"/>	0.46	36	39															
76	Circuit75	BS 88-2	10	C																												

Obr. 10.4: Merania s výsledkami sú automaticky vložené do správy

10.2 Exportovanie alebo tlač finálnej správy

Po skompletovaní všetkých stránok môže užívateľ vybrať preferovaný výstupný formát:



- **(Uložiť):** Správa sa uloží pod tým istým názvom do súboru štruktúry.



- **(Uložiť ako):** Správa sa uloží pod iným názvom do súboru štruktúry.



- **(Export to template):** Správa sa uloží do zvoleného priečinku ako šablóna (*.rtmpl).



- **(Tlačiť):** Vytlačí správu.



- **(do PDF):** Exportuje správu do pdf súboru; užívateľ bude vyzvaný na výber priečinku pre uloženie a zadanie názvu súboru.



Poznámka

Priama tlač na tlačiarni nemusí pracovať správne pre niektoré staršie typy tlačiarí. V takom prípade odporúčame najprv uložiť správu do súboru pdf, a tento súbor následne vytlačiť. (na to je potrebné mať nainštalovaný Adobe® Acrobat reader®, dostupný na [<http://get.adobe.com/uk/reader>]).


10.3 Pro Export do formátu súboru Excel

Funkcia Pro Export umožňuje exportovanie údajov do súboru excel.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od licenčných práv prístroja, ktorým boli merania urobené. Licencia BASIC túto funkciu neponúka.

Funkcia je dostupná z hlavného menu programu, pozrite **Obr. 10.5**. Ponuka je aktívna len ak je otvorený príslušný súbor.

Užívateľ si môže vybrať rozsah objektov, pre ktoré sa má urobiť export. Budú exportované údaje zvoleného objektu a pod neho spadajúcich podobjektov. Ak sa zvolí uzol, exportovať sa bude kompletnejšia štruktúra.

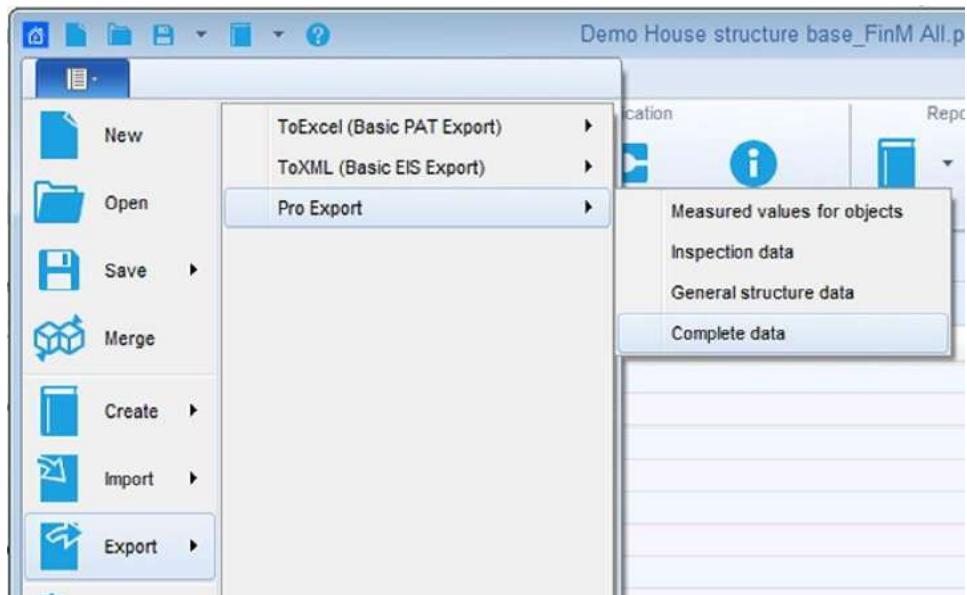

Obr. 10.5: Menu pre výber funkcie Pro export

Je možné vybrať si zo štyroch možností exportu:

- **Measured values for objects:** voliteľné údaje sú obmedzené na namerané údaje
 - **Inspection data:** voliteľné údaje sú obmedzené na údaje kontroly
 - **General structure data:** voliteľné údaje sú obmedzené na údaje štruktúry
 - **Complete data:** je možný výber zo všetkých údajov (merania, kontroly, štruktúra).

Po výbere sa zobrazí náhľadové okno, **Obr. 10.6.**

Obr. 10.6: Okno s náhľadom údajov pre export

Okno obsahuje tieto časti:

- Tabuľka s prehľadom údajov (1).
 - Zaškrťacie polička pre výber užívateľom (2).
 - Funkčné tlačidlá (3).
 - Príkazová lišta (4).

Tabuľka s prehľadom údajov

Namerané údaje sa zobrazujú v samostatných radkoch pre každý test pripojený k vybranému objektu. Zobrazujú sa tieto stĺpce:

- PATH_NAME: Popis cesty v štruktúre k testovanému objektu
- PATH_TYPE: Popis typu objektu
- AS_NAME: Názov testovanej postupnosti Autosequence® pripojenej k objektu
- MEAS_NAME: Názov jednotlivého testu
- Comment: Komentár pridaný k testu
- Status: Status jednotlivého testu
- User: meno obsluhy prístroja
- Serial: Výrobné číslo prístroja
- Firmware version: Verzia FW prístroja
- Calibration date: Dátum kalibrácie prístroja

Používateľ môže pridať ďalšie stĺpce označením políčok v pravej časti okna.

Zaškrťavacie polička

Užívateľ môže do tabuľky pridať ďalšie stĺpce podľa svojho výberu, a to označením príslušného polička:

- Objekty štruktúry
- Merania
- Kontroly

Údaje sa vyberú označením prázdnego štvorčeka pre názvom. Opäťovným kliknutím na štvorček sa údaje odznačia. Trojuholník pred políčkom znamená, že pre výber existujú aj pod-údaje. Kliknutím na trojuholník sa rozbalí zoznam.

Funkčné tlačidlá



Save filter (Uložiť filter): Po ukončení výberu údajov môže užívateľ uložiť tento výber ako súbor *filename.filter*. Po kliknutí na tlačidlo môže užívateľ priečinok na uloženie a zadať názov súboru.



Load filter (Načítať filter): Uložený filter môže byť natiahnutý do iného súboru, aby sa použil ten istý výber údajov. Súčasne môže byť otvorený len jeden filter; otvorením ďalšieho sa prepíše predchádzajúci.



Check all (Označiť všetko): Označí všetky dostupné údaje



Uncheck all (Odznačiť všetko): Odznačí všetky dostupné údaje

Príkaz ‘do Excelu’



to Excel: (do Excelu) Po výbere požadovaných údajov sa kliknutím na tlačidlo vytvorí súbor typy Excel. Otvorí sa prehliadač, užívateľ vyberie umiestnenie a názov súboru.

11 Menežovanie správ

11.1 Menežovanie správ

Prístup k menežovaniu správ je z menu Správy, ak je otvorený súbor so štruktúrou. Manežovať (spravovať) možno všetky už skôr vytvorené a uložené správy súvisiace s otvoreným súborom:



- **Manage** (Spravovať): Kliknutím na ikonu sa otvorí zoznam existujúcich správ (**Obr. 11.1**). Každú správu možno upravovať, vymazať alebo znova vytvoriť (❶):

- (Vymazat): Vymazanie správy

- (Otvorit): Otvorenie správy

- (Vytvoriť znova): Opäťovné vytvorenie správy (aktualizácia s novými údajmi zo súboru)



- **Refresh** (Obnoviť): Obnoví sa zoznam

Report Name	Creation Date	Structure path
PR5	29.4.2014	ROOT//GARAGE
CR6	12.6.2014	ROOT//GARAGE
EICR	26.5.2014	ROOT//GARAGE
ECIM	12.6.2014	ROOT//GARAGE

Obr. 11.1: Okno pre menežovanie správ


11.2 Opäťovné vytvorenie správ

Všetky existujúce alebo uložené správy môžu byť opäťovne vytvorené pomocou príslušného tlačidla. Znovu vytvorením sa report aktualizuje novými údajmi z otvoreného súboru dátovej štruktúry. Všetky staršie údaje v správe, ktoré neboli aktualizované, zostávajú bez zmeny.



- **(Vytvoriť znova)**: Po kliknutí na ikonu sa najprv zobrazí okno s upozornením (**Obr. 11.2**):
 - "Niektoré údaje môžu byť zmenené alebo prepísané". Potvrďte pre pokračovanie.
 - Nasleduje možnosť použiť filter. Zvoľte Áno alebo Nie.

- Otvorí sa okno pre editáciu správy, ktoré umožňuje urobiť ďalšie úpravy, a následne ho uložiť alebo exportovať ako šablónu.

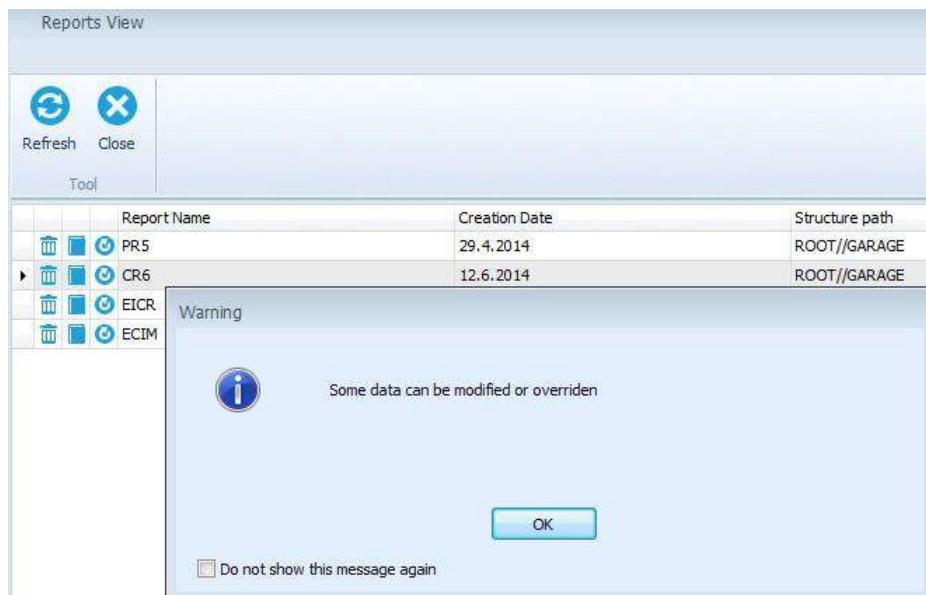


Obr. 11.2: Znovu vytvorenie správy

12 Šablóny správ

12.1 Úprava šablón správ

Správy možno exportovať ako Šablóny správ (súbor "*.rtmpl"). Tieto možno následne použiť v kombinácii s rôznymi súbormi (projektmi). Úprava šablón je dostupná z hlavného okna v časti Nástroje:


-  **Template Editor** (Editor šablóny): Otvorí sa prehliadač pre výber priečinku so šablónami. Zvolený súbor (*.rtmpl) je otvorený v okne pre editáciu (**Obr. 12.1**). Okno obsahuje:
 - Riadok s príkazmi (❶).
 - Stránky šablóny (každá stránka má vlastnú záložku) (❷).
 - Rozloženie (vzhľad) stránky (❸).
 - Tlačidlá pre zoznamy databáz (❹).
- **Vkladanie údajov:**
 - Užívateľ môže kliknúť na každé pole a upravovať ho.
 - Kliknutím na tlačidlo vľavo sa otvorí príslušná databáza s údajmi pre vloženie do príľahlého poľa.
-  **Save** (Uložiť): Uloženie šablóny pod tým istým názvom.
-  **Save as** (Uložiť ako): Uloženie šablóny pod iným názvom.

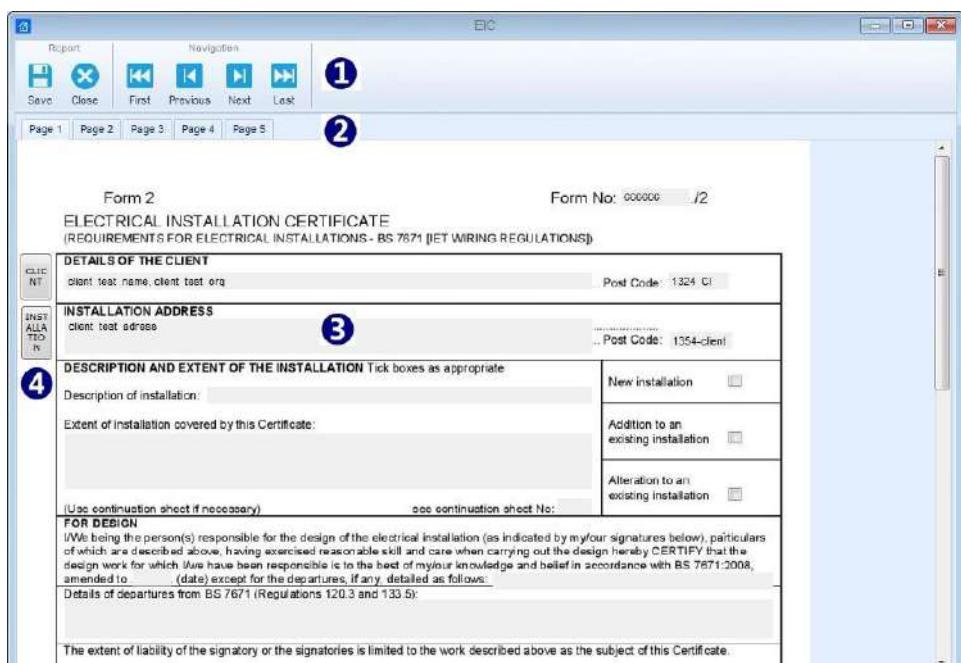

Obr. 12.1: Okno pre editáciu šablóny

12.2 Použitie šablón správ

Uložené šablóny možno využiť pri príkaze Vytvorit' zo šablóny (dostupné z hlavného okna, časť Správy / Vytvorit'):

- 
- (Vytvorit' zo šablóny): Otvorí sa prehliadač pre otvorenie priečinku s uloženými šablónami; vyberte jednu a kliknite Otvorit'.
 - Zobrazí sa okno pre možnosť použiť filtrovanie.
 - Šablóna sa otvorí v okne pre úpravu:
 - Merania súvisiace s meraniami otvorenej štruktúry sú aktualizované, ostatné merania sú pridané do správy.
 - Ostatné predchádzajúce údaje zostanú bez zmeny.
 - Formulár údajovej štruktúry zostáva rovnaký a nemôže byť zmenený.
 - Užívateľom editovateľné polia možno upravovať.
 - Vytvorená správa môže byť uložená alebo exportovaná ako šablóna.
 - Vytvorenú správu možno uložiť do pdf, alebo priamo vytlačiť na tlačiarni.

13 Riešenie problémov

13.1 Úvod

Táto časť obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov s programom Metrel ES Manager. Ak tu nenájdete hľadané riešenie, môžete nás kontaktovať aj priamo.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole 14 [Online podpora](#).

Vaše pripomienky nám pomôžu zlepšiť náš produkt a spresniť/doplniť tento návod.

13.2 Problém s pripojením prístroja



Obr. 13.1: Chybové hlásenie súvisiace s pripojením prístroja

Ak sú nastavenia prístroja správne a komunikácia stále nefunguje, skúste toto:

- Uistite sa, že pripojovací kábel nie je poškodený a konektory sú dobre pripojené. Ak máte možnosť, overte si funkčnosť kábla na inom podobnom zariadení.
- Uistite sa, že sú zatvorené všetky aplikácie, ktoré môžu používať zapojený port. Prípadne skúste reštartovať Windows.
- Ak to nepomohlo, problém môže byť s ovládačom zariadenia pre port, ktorý používate. Môžete skúsiť preinštalovať alebo opraviť MESM, čím sa obnovia aj USB ovládače (drivers).

13.3 Oznámenie chyby do Metrelu

Ak pri používaní programu Metrel ES Manager narazíte na neočakávaný problém, dajte nám o tom vedieť na <metrel@metrel.si>. Pokúsime sa nájsť riešenie čo najrýchlejšie a poskytnúť vám požadovanú pomoc.

13.3.1 Obsah správy o chybe programu

Ak sa rozhodnete obrátiť sa na nás s požiadavkou o pomoc, vaša správa by mala obsahovať:

- Stručný popis problému, a hlavne kroky, ako chybu navodiť;
- „Log“ súbor programu Metrel ES Manager (je umiestnený v priečinku ... \MESM\Log\).

14 Online podpora

14.1 Ako získať podporu?

14.1.1 Kontaktujte nás priamo

Metrel d.d. Slovenia
Ljubljanska cesta 77
Horjul, SI-1354 Slovenia
Phone: +386 1 7558 200
Fax: +386 1 7549 226
E-mail: metrel@metrel.si

Váš dodávateľ:



MERATEST s.r.o.

Družstevná 2, 916 01 Stará Turá
Mobil: +421 903 533 859
Tel.: +421 32/642 0909
E-mail: molec@meratest.sk
www.meratest.sk

Web site: www.metrel.si [<http://www.metrel.si/>]

14.1.2 Využite online kontaktný formulár

Môžete tiež použiť kontaktný formulár [Contact form](https://www.metrel.si/en/contact/) [<https://www.metrel.si/en/contact/>].