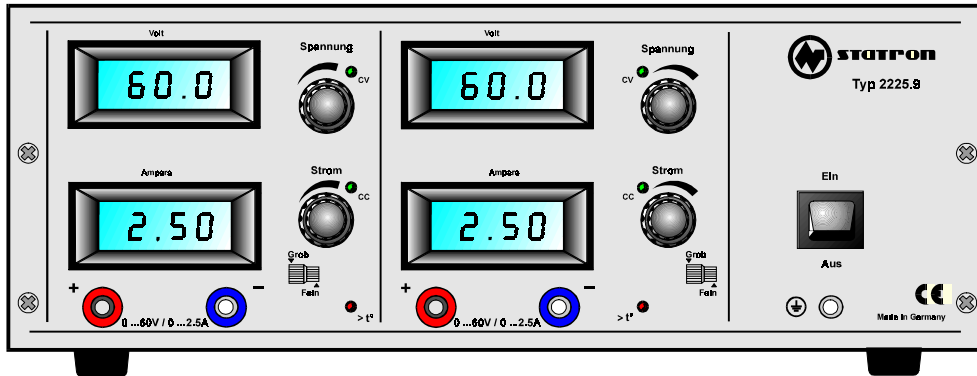


**STATPON**
A.W.V.**Standardní laboratorní zdroje
stolní přístroje****Jmen. výkon****300 W****Popis**

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
 CC = constant current (zdroj konst. proudu)

**techn. parametry**

Specifikace	Typ	2225.6		2225.9	
		0-30V	0-30V	0-60V	0-60V
DC		0-30V	0-30V	0-60V	0-60V
DC		0-5A	0-5A	0-2,5A	0-2,5A
	CV stabilita (sítě +6/-7%)	2mV	2mV	2mV	2mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	50mV	50mV	50mV	50mV
	CV zvlnění (Ueff)	1mV	1mV	1mV	1mV
	CC stabilita (sítě +6/-7%)	3mA	3mA	3mA	3mA
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	2mA	2mA	2mA	2mA
	CC zvlnění (I eff)	3mA	3mA	3mA	3mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	200μs	200μs	200μs	200μs
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)			
	rozlišení	0,10% z max. rozsahu			
	výstupní charakteristika	U / I			
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3,5-místný LCD)			
	výstup	4 mm přístr. svorky		4 mm bezpečnostní přístrojové svorky	
	provozní teplota	0 - 35°C			
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C			
AC	vstupní napětí	230 V +5% / -7% 48-62Hz			
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC			
	třída přístroje	I.			
	krytí	IP 30			
	vyrobena podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B			
	rozměry Š x V x H (mm)	360x150x230			
	hmotnost	11 kg			

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
 Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
 e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

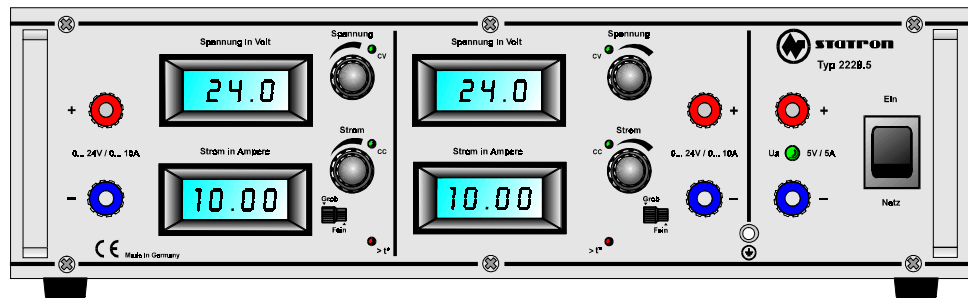
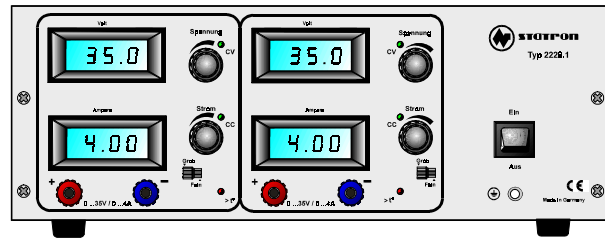
Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !

**STOTRON**
A.W.V.**Standardní laboratorní zdroje
stolní přístroje****Jmen. výkon****500 W****Popis**

- lineární regulace
- tepelná pojistka
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země
- rukojeť pro uchopení u 2228.5

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)

CC = constant current (zdroj konst. proudu)

**techn. parametry**

Specifikace	Typ	2228.1		2228.5			
DC	výstupní napětí	0-35V	0-35V	0-24V	0-24V	5V	
DC	výstupní proud	0-4A	0-4A	0-10A	0-10A	5A	
	CV stabilita (síť +5/-7%)	2mV	2mV	2mV	2mV	5mV	
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	50mV	50mV	50mV	50mV	30mV	
	CV zvlnění (Ueff)	1mV	1mV	1mV	1mV	1mV	
	CC stabilita (síť +5/-7%)	3mA	3mA	3mA	3mA		
	CC stabilita (zátěž 0-100%)						
	CC zvlnění (I eff)	3mA	3mA	3mA	3mA		
	reg. čas při zátěži 10-100%	200µs					
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)					pevn.
	rozlišení	0,10% z max. rozsahu					
	výstupní charakteristika	U / I					foldback
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3-místný LCD), na přání analogové třídy 5					LED
	výstup	4 mm přístr. svorky					
	provozní teplota	0 - 35°C					
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C					
AC	vstupní napětí	230 V +6% / -7% 48-62Hz					
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC					
	třída přístroje	I.					
	krytí	IP 30					
	vyrobena podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křívka B					
	rozměry Š x V x H (mm)	360x140x260		451x134x324			
	hmotnost	11 kg		14 kg			

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
 Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
 e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !